


Urinmikroskopi i almen praksis

Sanne Malig og Sisse de Siqueira
Bioanalytikerundervisere

Flemming Schønning Rosenvinge
Overlæge

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
OUH

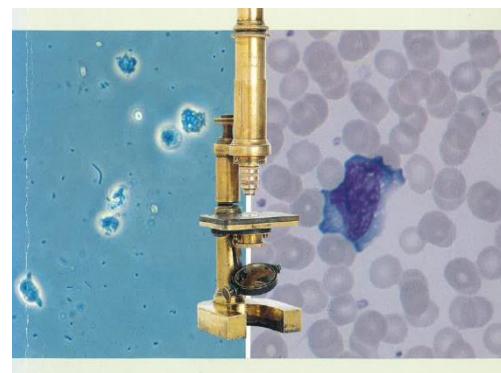

Urinvejsinfektion i almen praksis

- 2-5% af alle henvendelser i almen praksis
- Cystitis:
 - Dysuri
 - Pollakisuri
 - Evt. feber
 - Uklar og evt. blodig urin
 - Børn: Feber, mavesmerter, opkastninger, dårlig trivsel etc.
- Komplikationer:
 - Ascenderende UVI (især akut pyelonephritis)
 - Sepsis

Urinvejsinfektion

definitioner

- **Akut ukompliceret bakteriel cystitis**
 - Bakteriuri + symptomer
- **Kompliceret UVI**
 - Bakteriuri + symptomer
 - Børn
 - Mænd
 - Gravide
 - Sten, afløbshindring, misdannelser etc.
 - Kroniske sygdomme
 - Recidiverende UVI
 - Ascenderende UVI
 - IKKE alle postmenopausale kvinder
- **Asymptomatisk bakteriuri (ikke UVI)**
 - Signifikant bakteriuri uden symptomer (20% af kvinder og 10% af mænd > 65 år)

Akut uretralt syndrom:

Urinvejsinfektion

chlamydia, herpes, candida,

gonore, østrogenmangel,

irritation, kuldeeksposition etc.

(UVI med < 10e5 bakterier pr.ml.)

50% med symptomer på UVI har
ikke signifikant bakteriuri

Klinik

Stiks

Mikroskopi

Dyrkning

Dyrkning og
resistensbestemmelse

AP

KMA

Akut ukompliceret cystitis

Kompliceret UVI



Urinvejsinfektion

Diagnostik- Prøvetagning


- Morgenurin – eller mindst to timer siden sidste vandladning
- Midtstråleurin
- Afvaskning er ikke nødvendig
- Engangsbæger ved undersøgelse i praksis (undersøges straks eller opbevares ved 5°C)
- Borsyreglas hvis forsendelse til KMA

Urinvejsinfektion

Diagnostik- Prøvetagning




Kass' kriterier for urinvejsinfektion

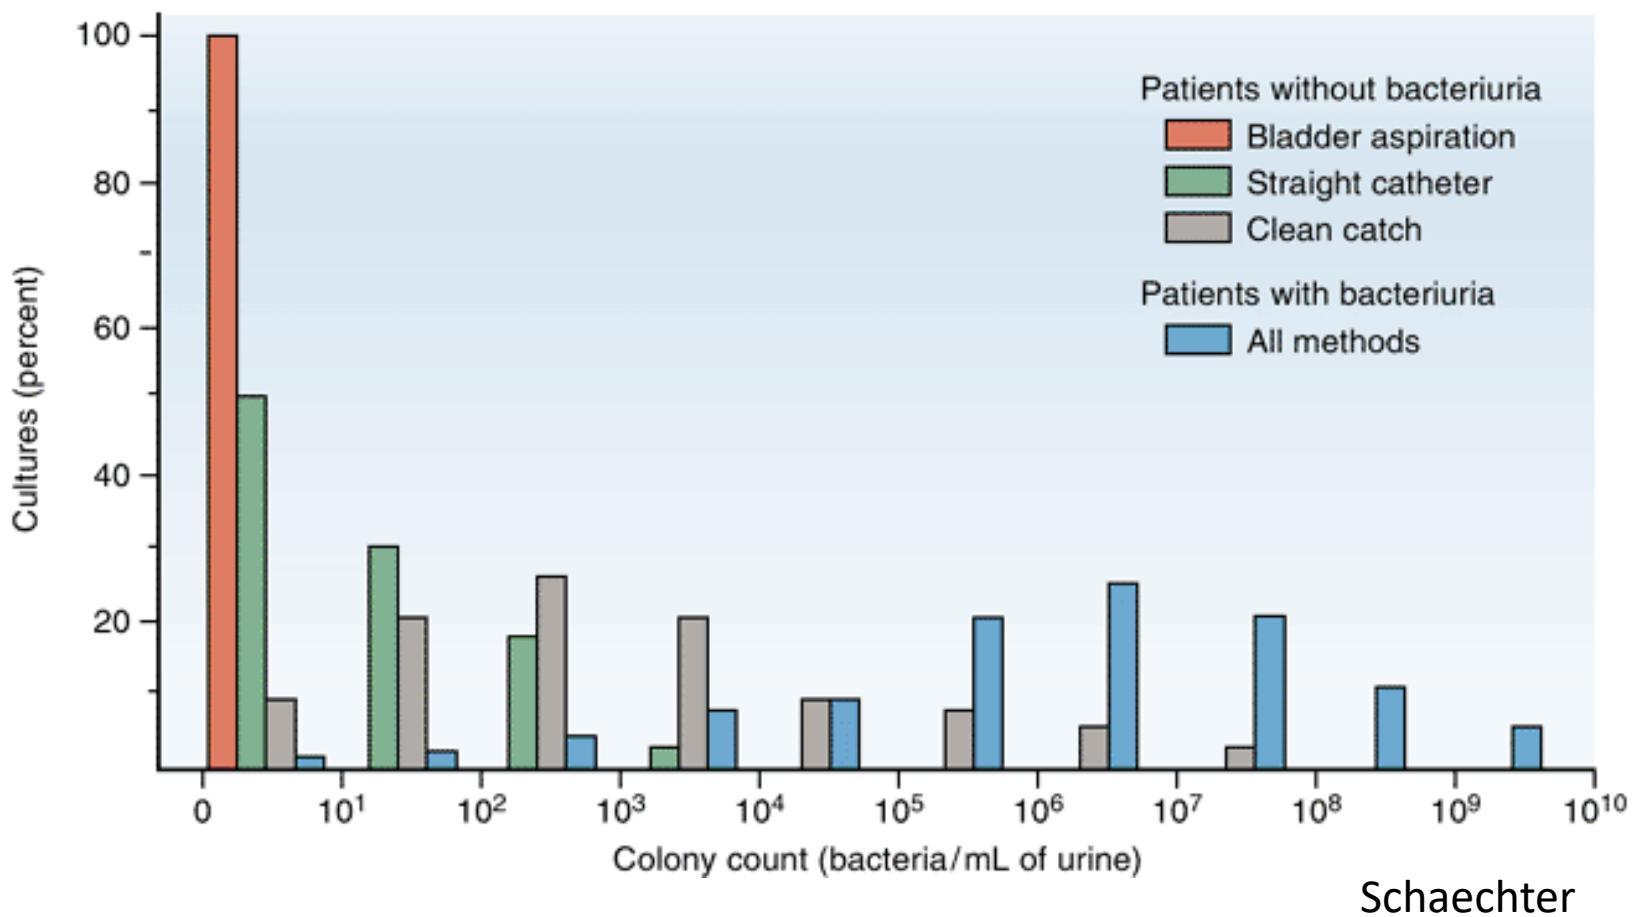



Bakt/mL

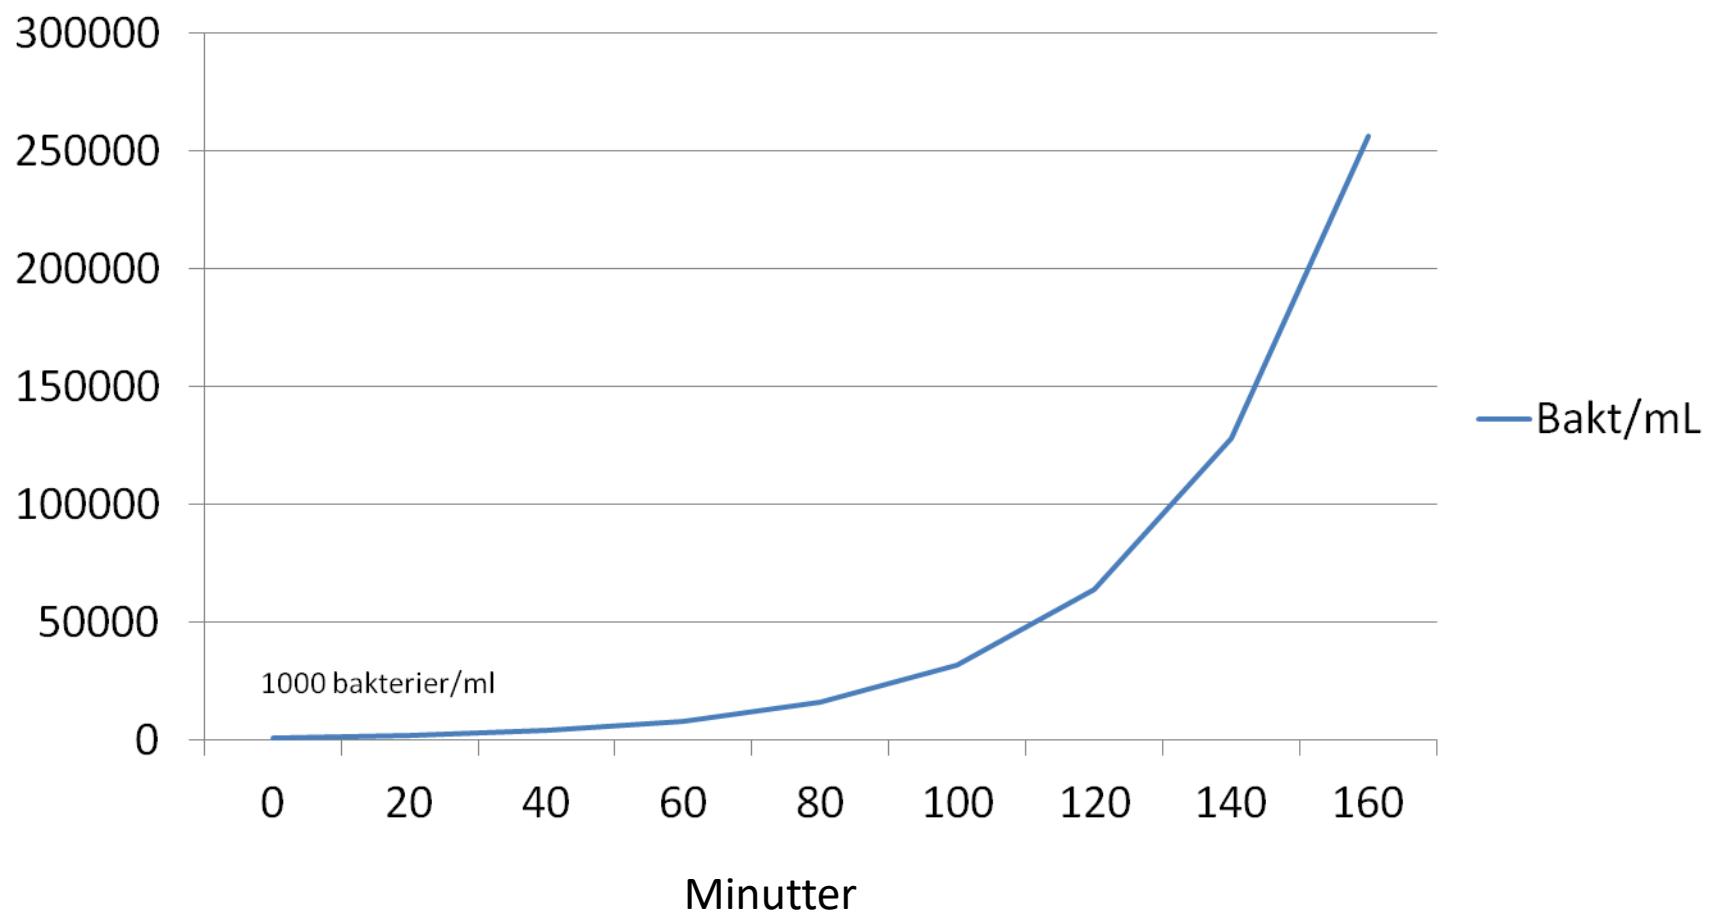



- Diagnosen UVI kan ikke stilles på klinik alene – diagnostik er nødvendig
- Fund af bakterier i en urinprøve betyder ikke UVI
- Man må ikke tage prøver på patienter uden symptomer (men enkelte undtagelser)
- Man må ikke behandle asymptotisk bakteriuri (men enkelte undtagelser)
- Forkert prøvetagning, -opbevaring og -transport giver falsk positive resultater

Urinvejsinfektion

diagnostik- stiks



Nitrit	Leukocytter	Resultat
0	0	Næppe UVI (kan være falsk negativ)
+	0	Bakteriuri – måske UVI?
0	+	Ca. 50% har UVI
+	+	Stor sandsynlighed for UVI

Nitritpåvisning er specifik men ikke sensitiv

Evt. negativ ved hyppig vandladning
(2 timer)
Negativ ved gram-positive kokker

Leukocytpåvisning er meget uspecifik men rimelig sensitiv


Leukocytter kan ved en række forskellige tilstænde bl.a. chlamydiainfektion, sten i urinveje, tumores, kemisk irritation

Urinmikroskopi

procedure

- Fasekontrastmikroskopi ved 400x
- Frisk urin (ingen centrifugering)
- Kapillærrør + Objektglas + Dækglas
- Se efter leukocytter og bakterier (+ epitelceller, erythrocytter mm)
- 20 synsfelter

Mikroskop

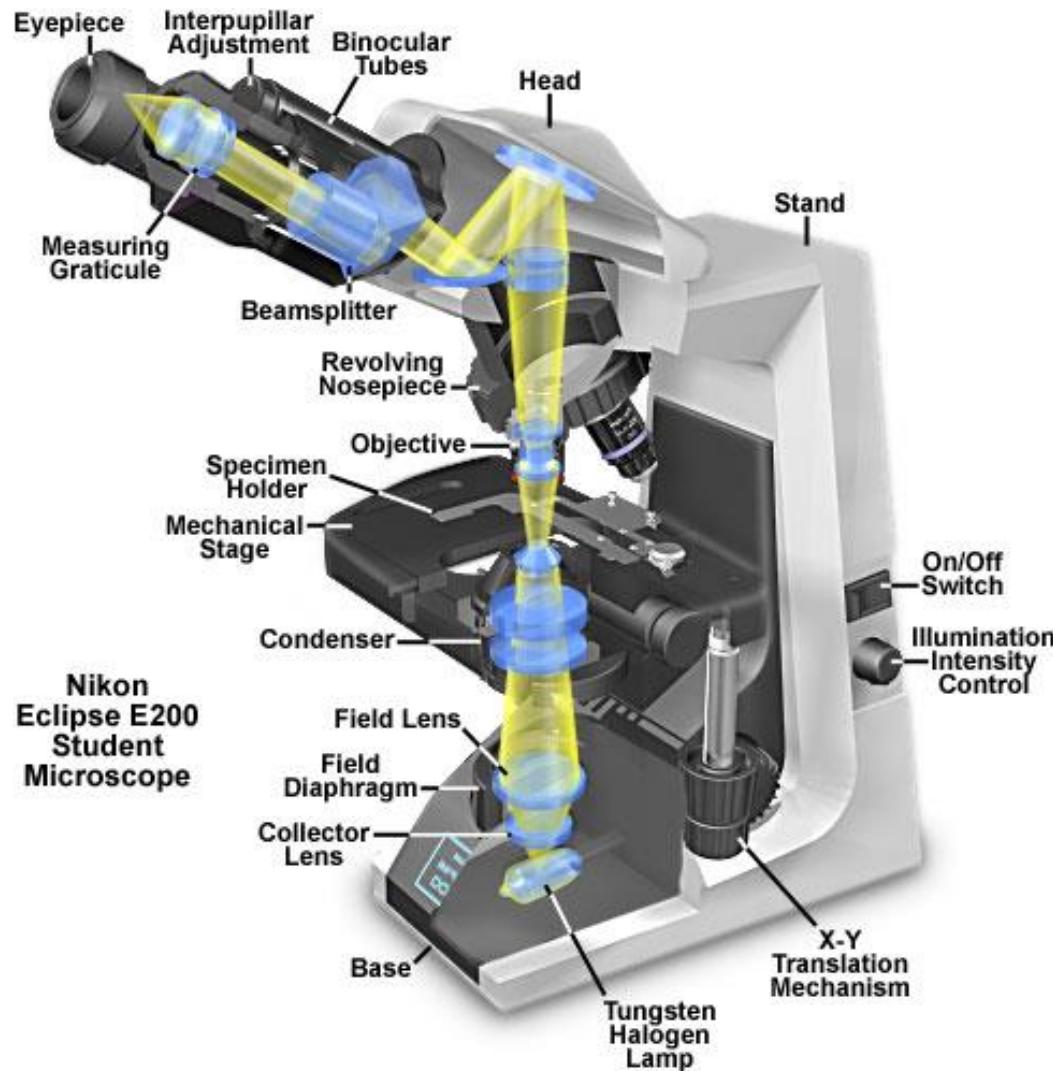


Mikroskop

KÖHLER INDSTILLING



Hvis det mikroskop, der er anskaffet, har mulighed for manuel indstilling, er dette den korrekte fremgangsmåde.

1. Stil skarpt med 10 x objektiv på præparatet.
2. Luk lysfeltblænden og aperturblænden, så lysfeltblænden ses tydeligt i synsfeltet.
3. Indstil kondensor-højden så lysfelt-blændens rand tegner helt skarpt.
4. Med kondensorens centreringskruer bringes lysfeltet nu ind i centrum af synsfeltet.
5. Lysfeltblænden skal åbnes, så den næsten når kanten af synsfeltet.
Efterkontroller og juster, at den følger kanten nøjagtigt.
6. Lysfeltblænden skal åbnes yderligere, så den netop passerer randen af synsfeltet.
7. Fjern det ene økular (aperturblændens bevægelse kan da ses) og åbn aperturblænden så meget, at ca. 3/4 af synsfeltet er belyst.

Hvis mikroskopet ikke har præcentrerede lamper, så vil første punkt i Köhlers indstilling være at centrere lampens filament.

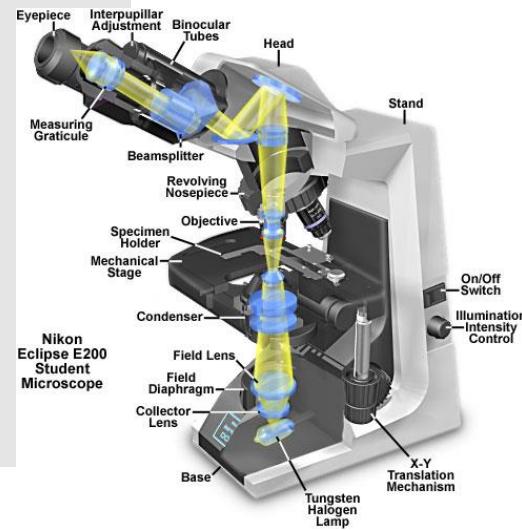


Fasekontrast mikroskop

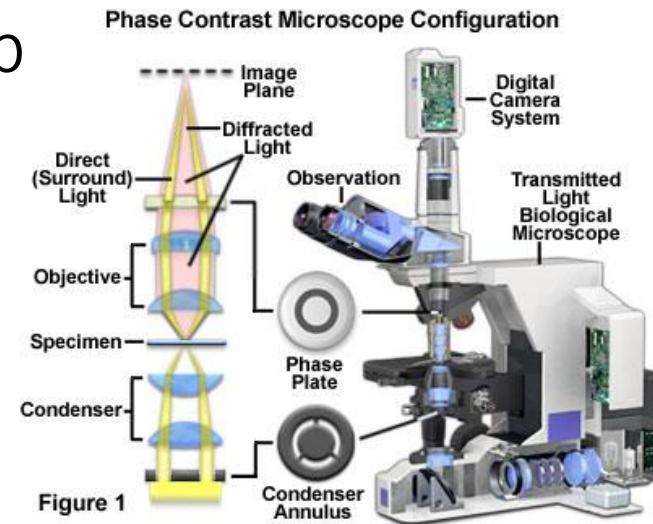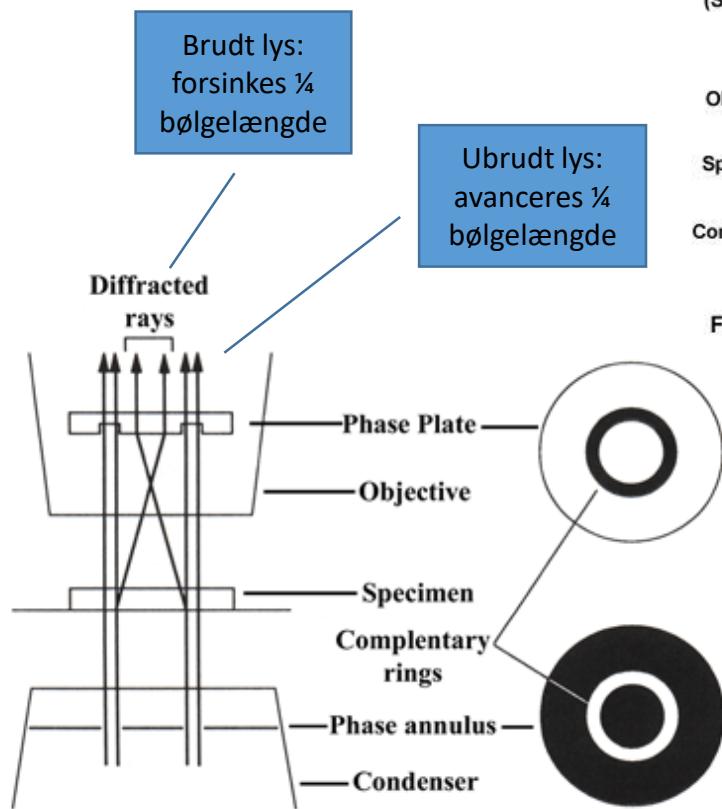


Fasekontrast mikroskop

FASE-KONTRAST INDSTILLING

1. Åbn aperturblænden helt og stil skarpt med 10 x fase - kontrastobjektiv.
 2. Stil fase-kontrast-kondensoren på 10 x.
 3. Fjern et af okularerne fra tubus og sæt centreringsokularet (CT-okularet).
 4. Med CT-okularet indstilles skarpt på de to fase-ringe, en lys og en mørk.
 5. Med centreringsskruerne centrerer den lyse ring, således at den dækker den sorte ring (se tegning).
 6. CT-okularet fjernes og mikroskopets okular genindsættes.
Kontroller/juster for hvert fase-objektiv der benyttes.
- Husk at tallet på fase-kondensor altid skal svare til objektiv-forstørrelsen.

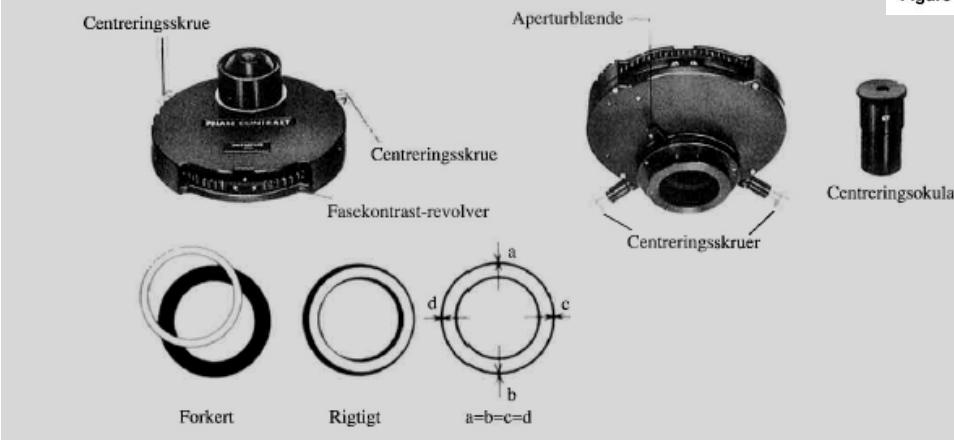

Phase Contrast Microscope Configuration

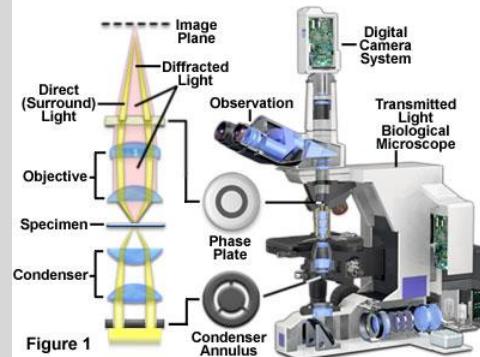

Urinmikroskopi

- UVI er en hyppig problemstilling
- Simpel og hurtig undersøgelse
- Billig
- Kan udføres mens patienten venter
- Rimelig sensitivitet ($\geq 10e5$).
- God specifikitet (hvis man kan)
- Den bakteriologiske ætiologi kan vurderes



Urinmikroskopi resultat

Pyuri

	Leukocytter /synsfelt	Bakterier og svampe /synsfelt
Nok UVI	≥ 1	≥ 1
Måske UVI	≥ 1	< 1
Bakteriuri - Næppe UVI	< 1	≥ 1
Næppe UVI	< 1	< 1



10e6 : 10 pr. synsfelt
10e5 : 1 pr. synsfelt
10e4 : 1 pr. 10 synsfelter
10e3 : 1 pr. 100 synsfelter

$\geq 10e5$ bakt/mL

Leukocytter går til grunde i løbet af en time

Urinmikroskopi

resultat

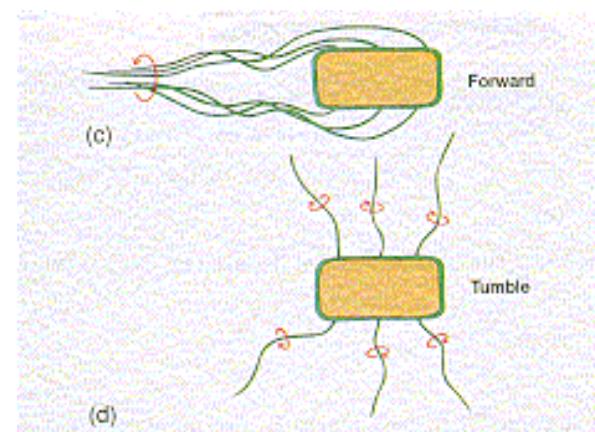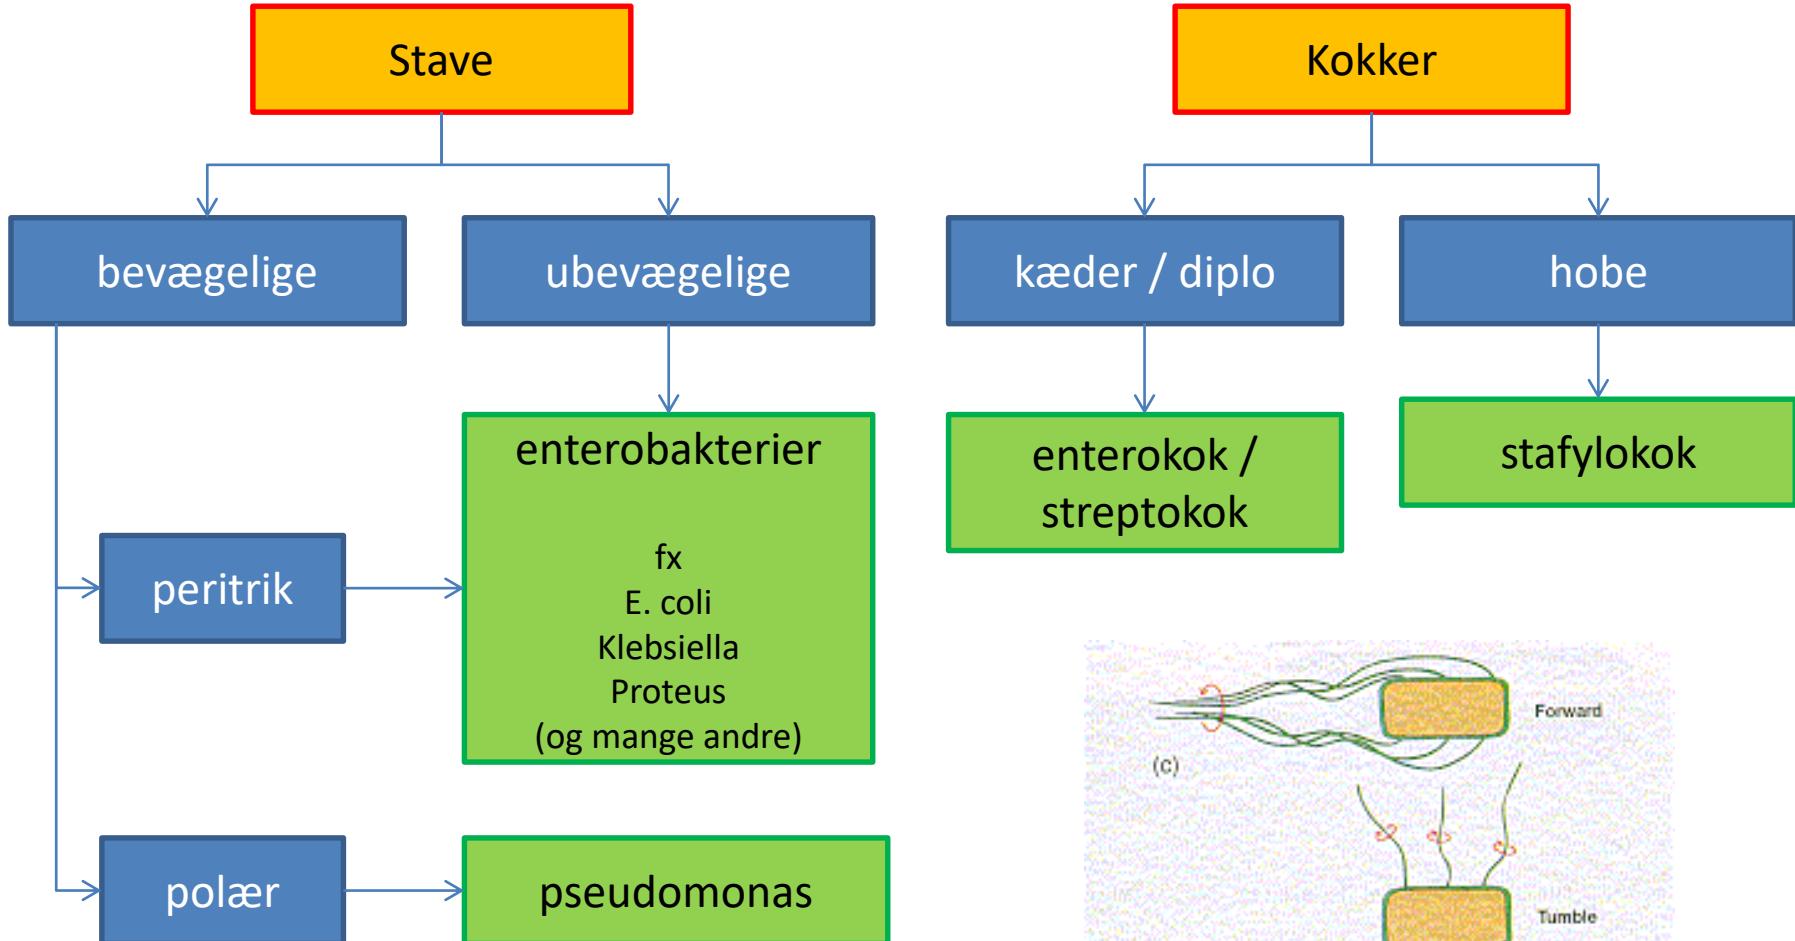

Skema til tolkning af mikroskopi

Tabel 1 / Bakteriernes morfologi og naturlige resistensmønster (fra Højbjerg et al: Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis – en praktisk vejledning. Urinvejsinfektioner. Fluor vaginalis. Leo Pharma Nordic 2010 (4).


Morfologi *) Bakteriernes flageller (svingtræde) ses ikke ved mikroskopi	Eksempler på bakterieart	Naturligt resistensmønster (resistens kan dog udvikles for et eller flere stoffer)
Peritrikt bevægelig stav (tumler, slår kolbøtter)	E. coli	Følsom for sulfonamid, ampicillin og mecillinam
Ubevægelig stav	Klebsiella	Følsom for sulfonamid og mecillinam, altid resistent for ampicillin
Polært bevægelig stav (hurtige bevægelser i lige linje som en raket eller en skøjteløber)	Pseudomonas	Resistent for de almindelige perorale antibiotika, ses ofte ved afløbshindring, blærekateter eller kompliceret UVI
Kokker i kæde (kokker bevæger sig ikke)	Enterokokker	Følsom for ampicillin og nitrofurantoin, intermidært følsom for trimethoprim, altid resistent for sulfonamid og mecillinam
Kokker i hobe Meget små, ligner næsten »grums« (kokker bevæger sig ikke)	Stafylokokker	Følsom for sulfonamid, altid resistent for mecillinam, de fleste stammer har erhvervet resistens for ampicillin
Gærceller meget større end bakterier, evt. med knopskydning (gærceller bevæger sig ikke)	Candida-arter	Resistent for antibiotika, ses ved blærekateter og afløbshindring, kan være slutresultat af talrige antibiotikakure
Stave, kokker og evt. gærceller	Blandingsflora	Ses ved blærekateter og afløbshindring
	Tilblanding	Dårlig prøvetagning med tilblanding af bakterier fra hud eller slimhinder

Mecillinam
Nitrofurantoin
Trimethoprim
Sulfonamid

Ampicillin
Nitrofurantoin

Nitrofurantoin
Trimethoprim
Sulfonamid

Urinmikroskopi resultat

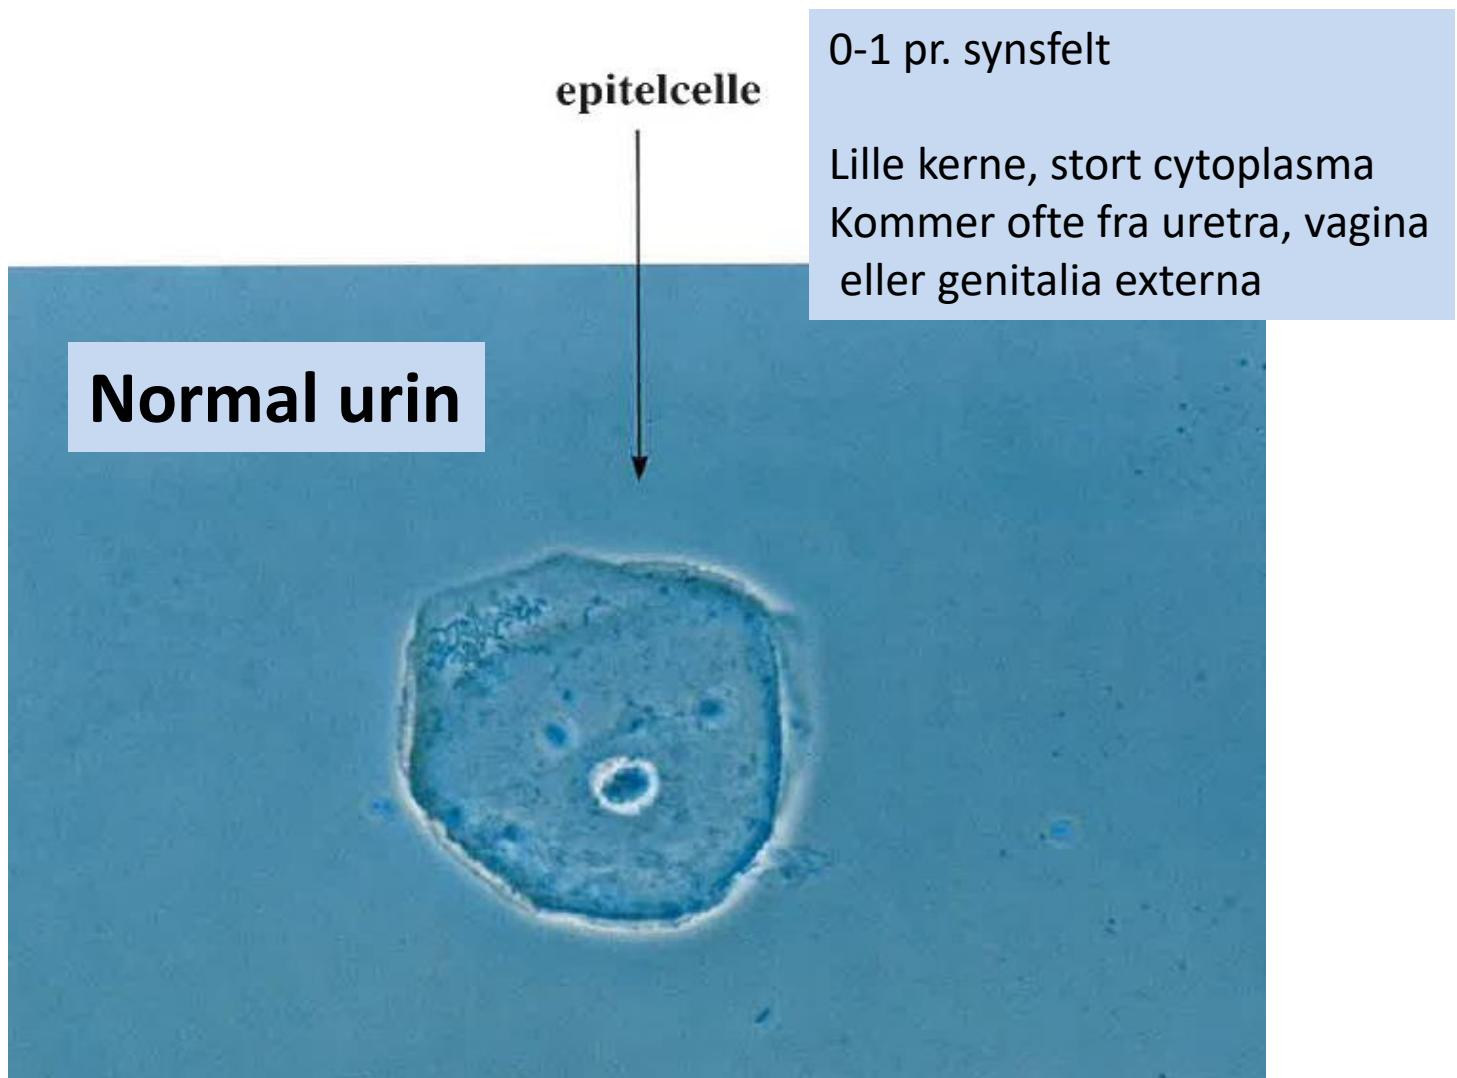

slimtråd

Slimtråde er et normalt fund

blæreepitelceller


Blæreepitelceller er mindre end epitelceller fra vagina og uretra


2-4 x størrelsen af en leukocyt

Højt antal kan bl.a. ses ved cystitis og neoplaesi.

Normal urin



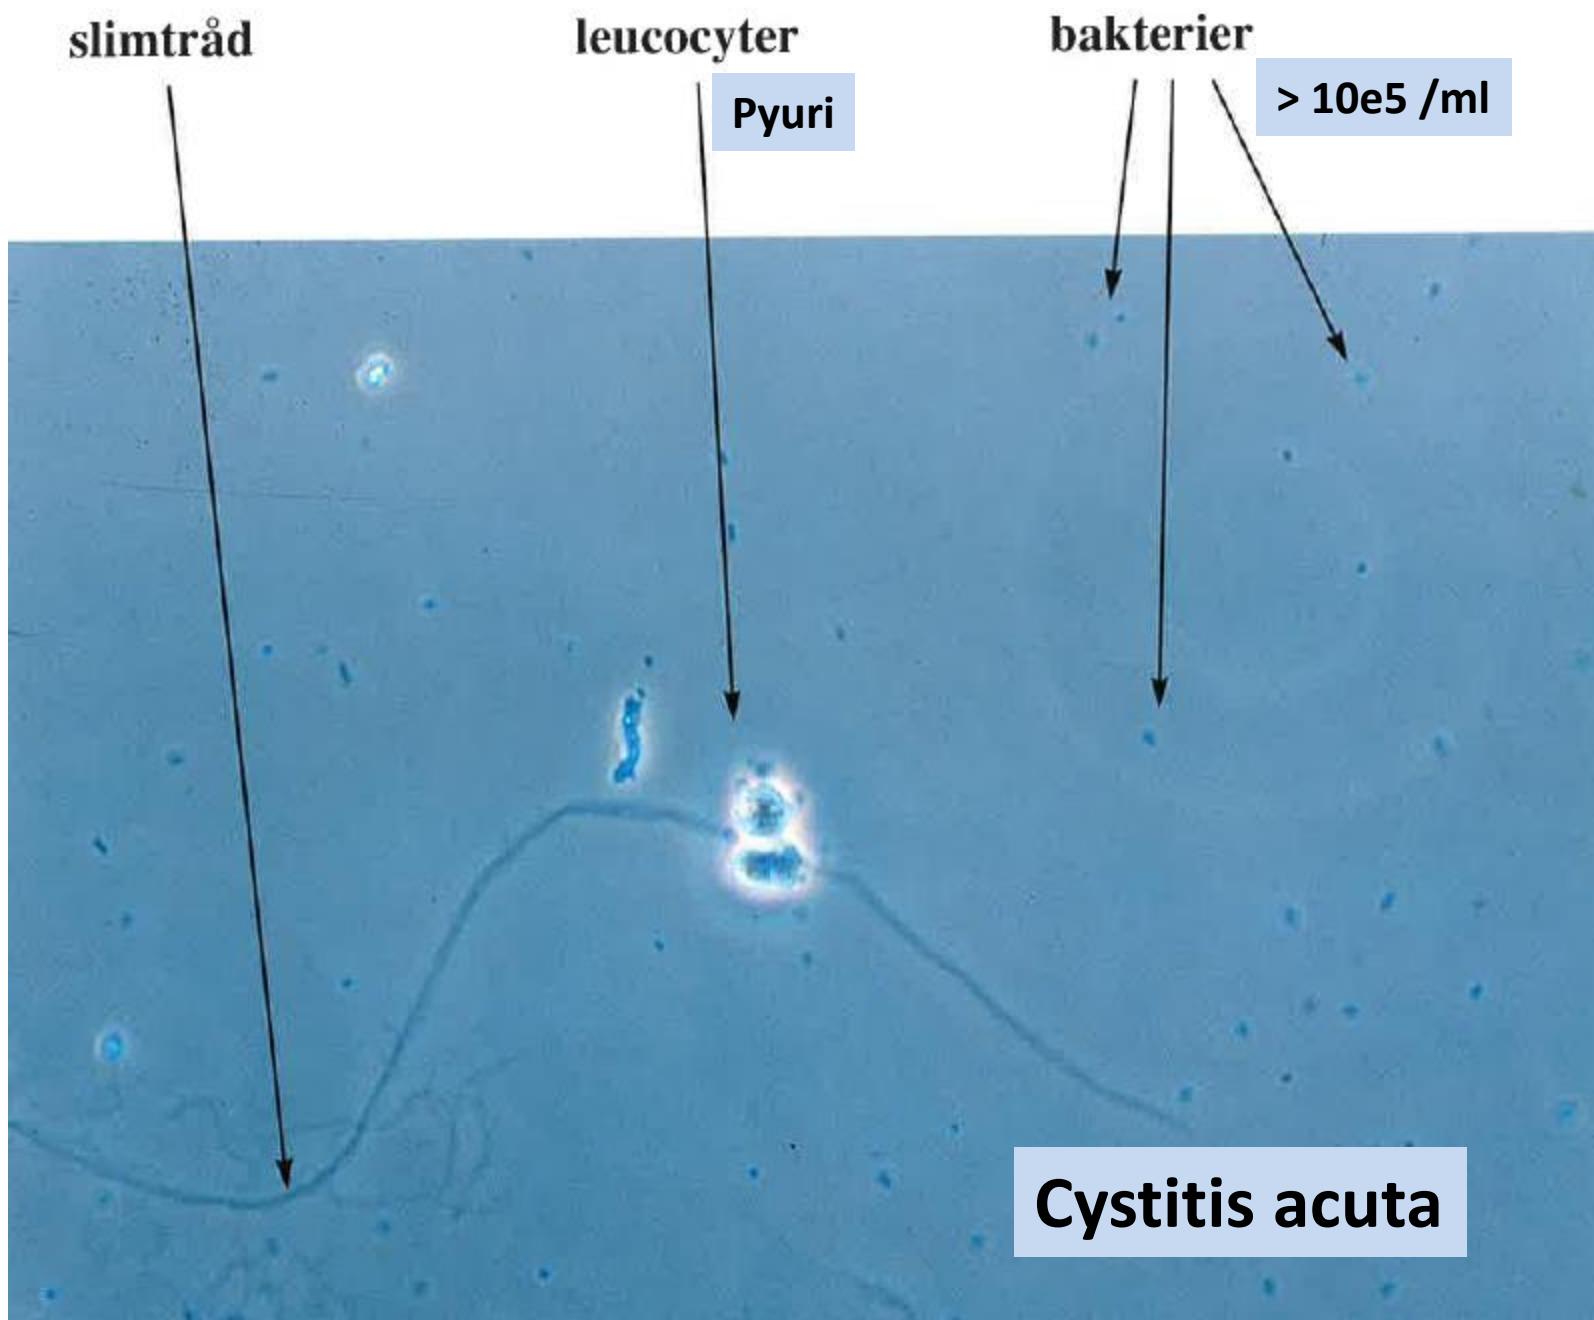

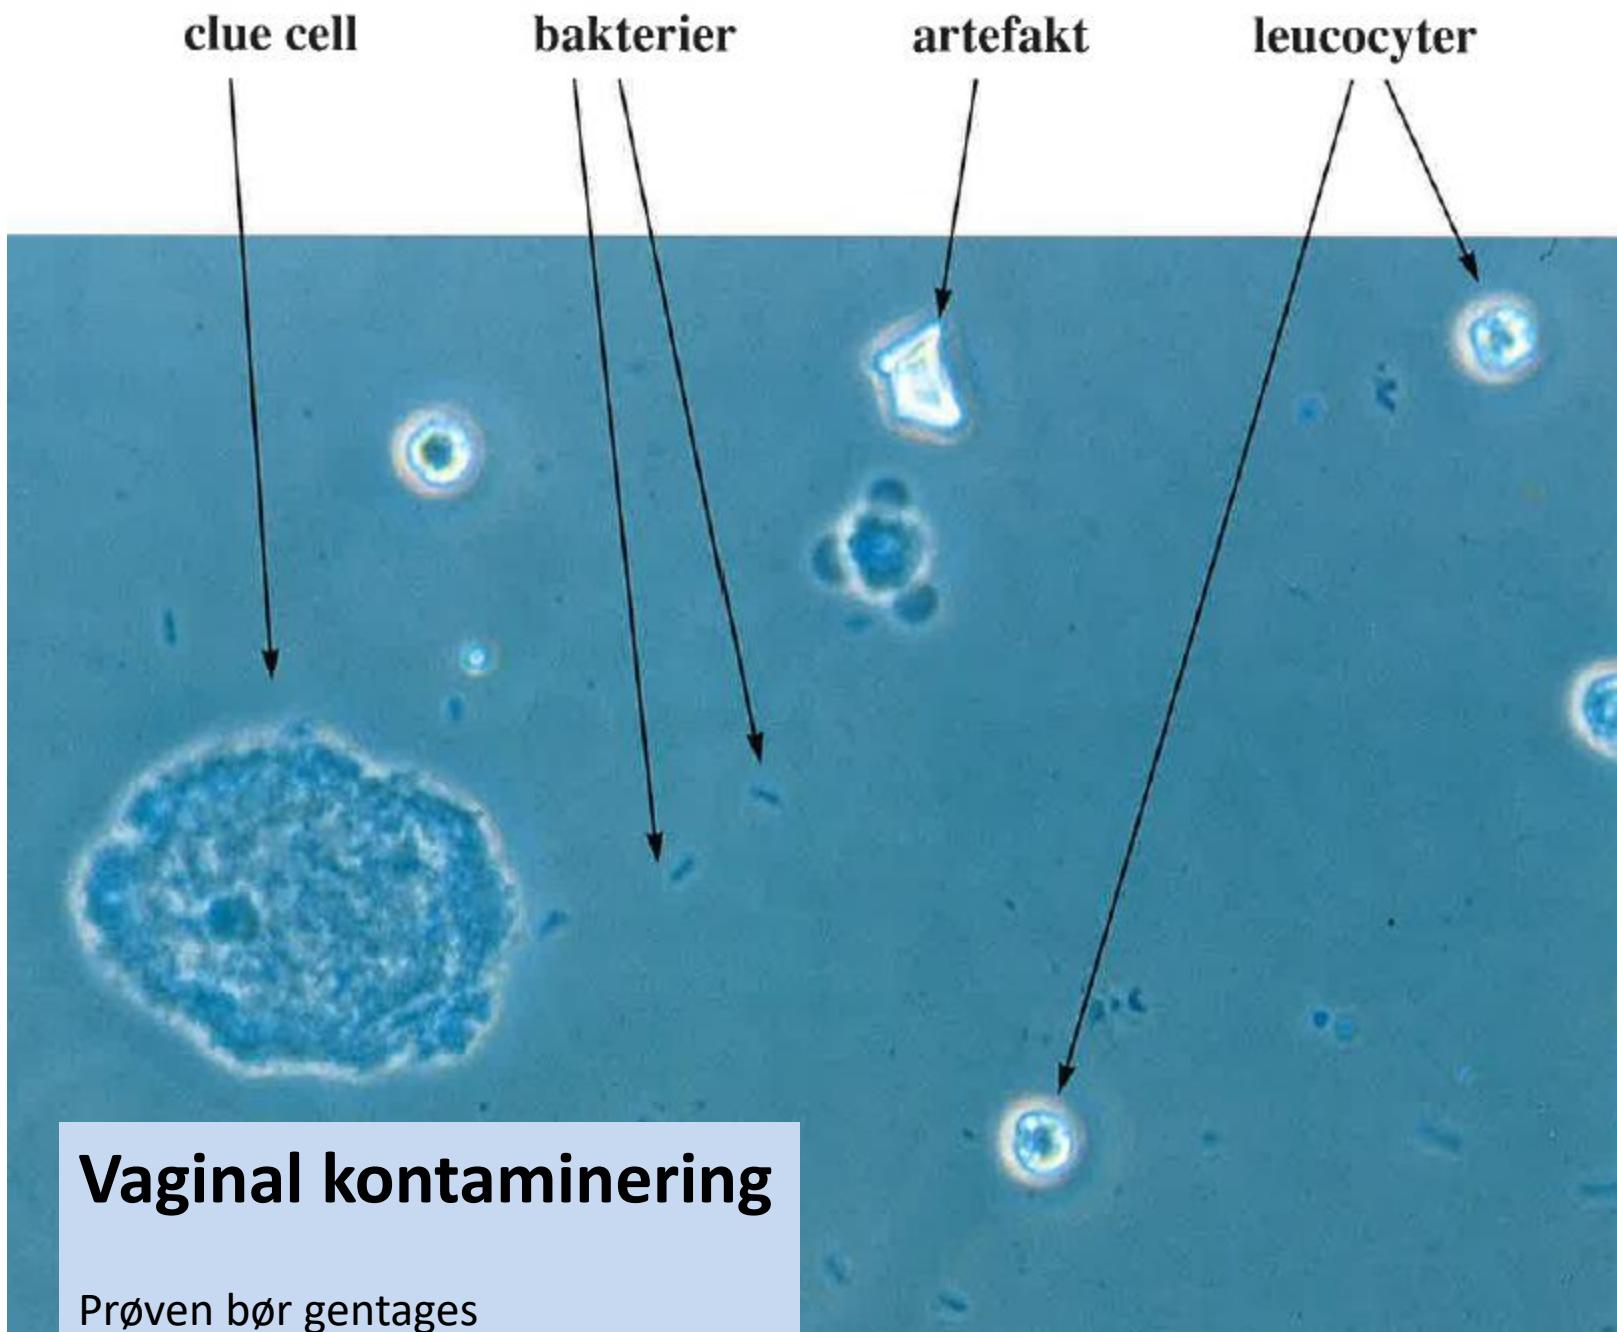

Vaginal kontaminering


Prøven bør gentages


bakterier (stave)


"klæber" til leukocytterne


leucocyter

Varierende morfologi

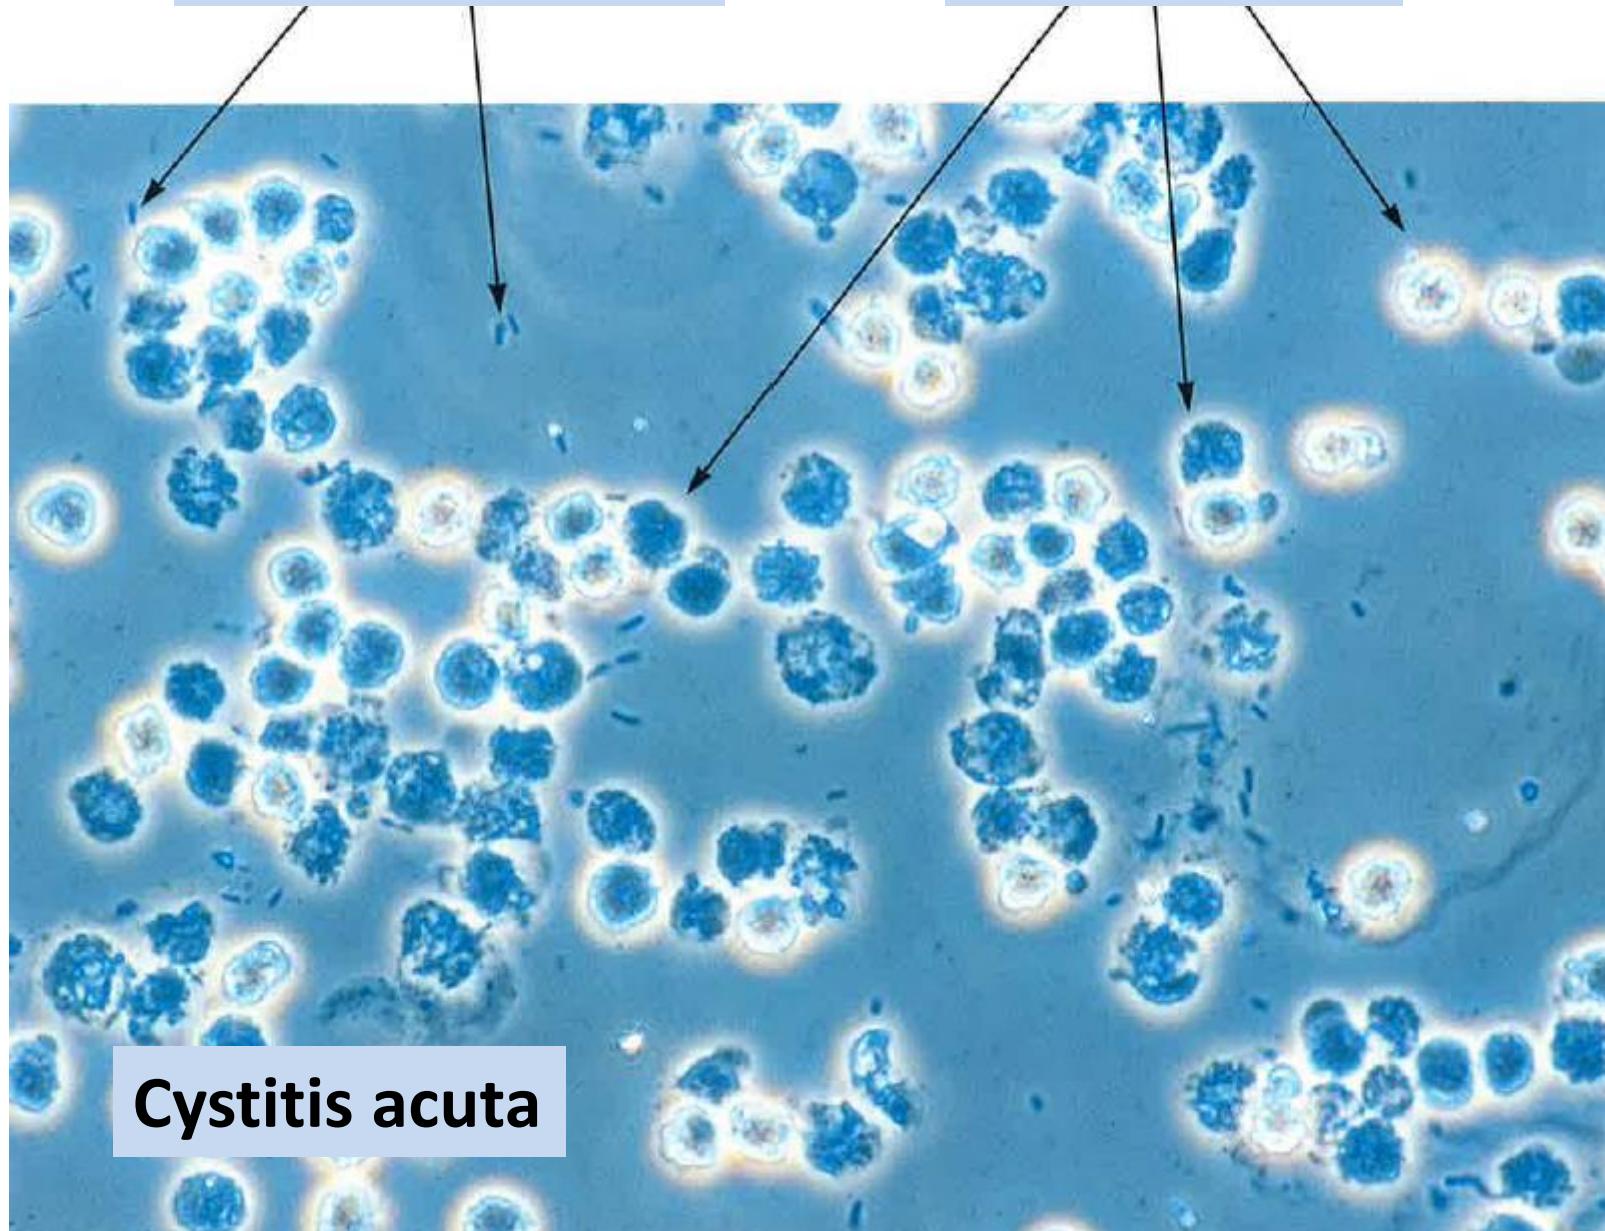

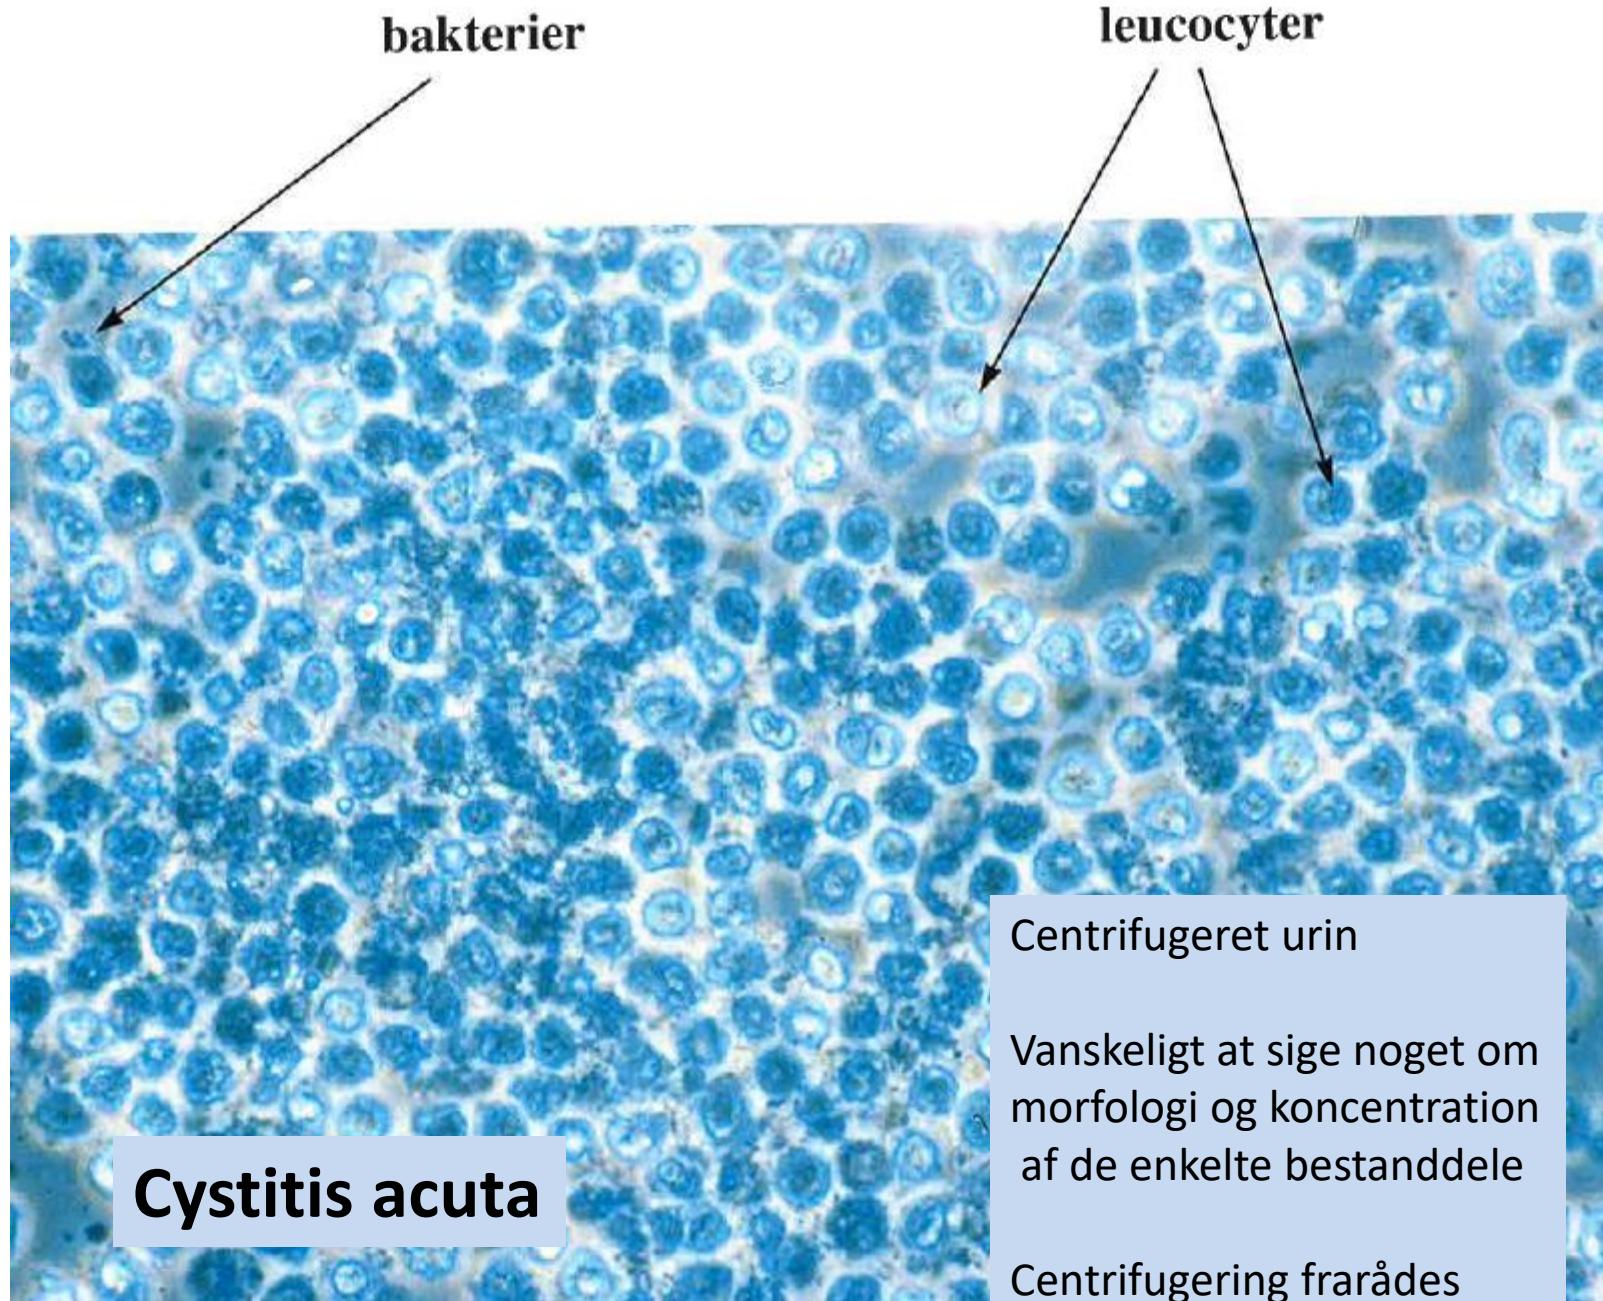

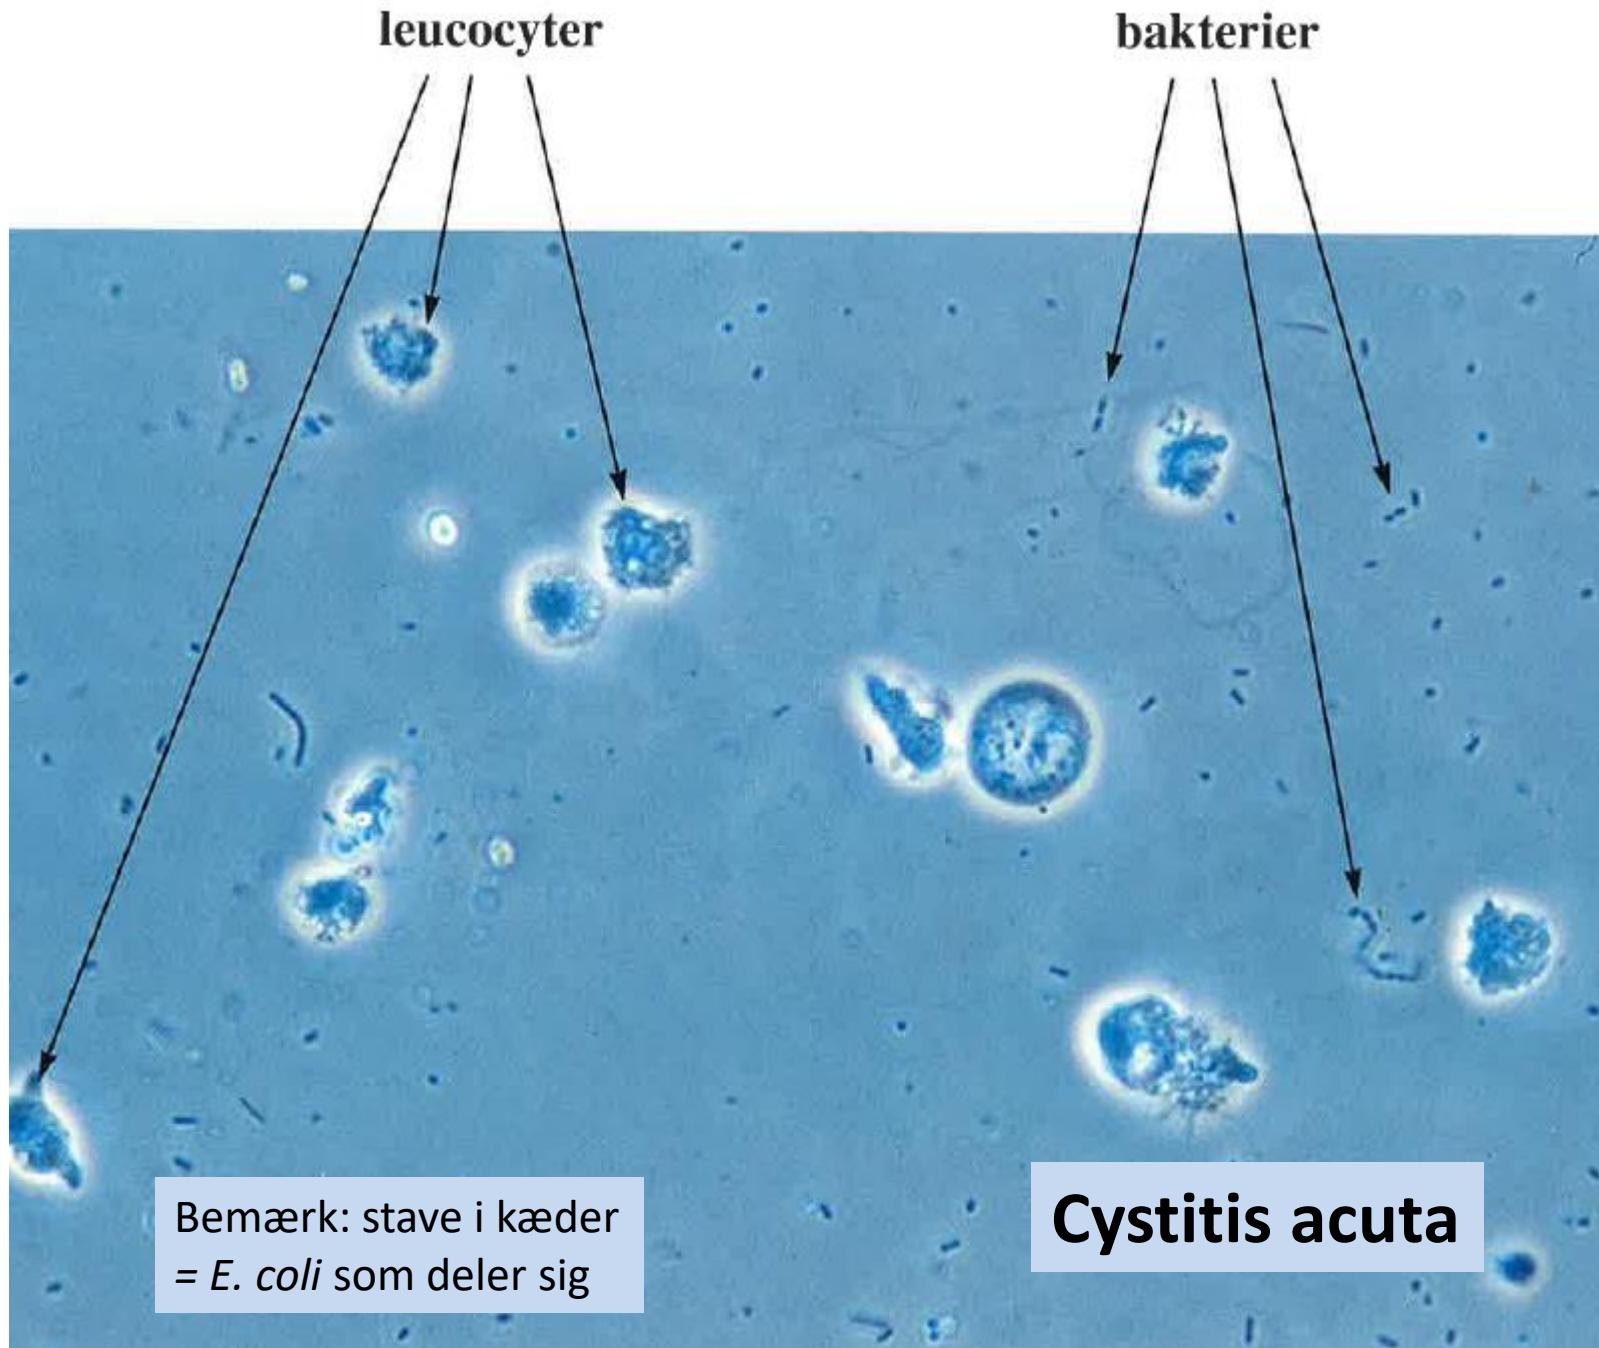


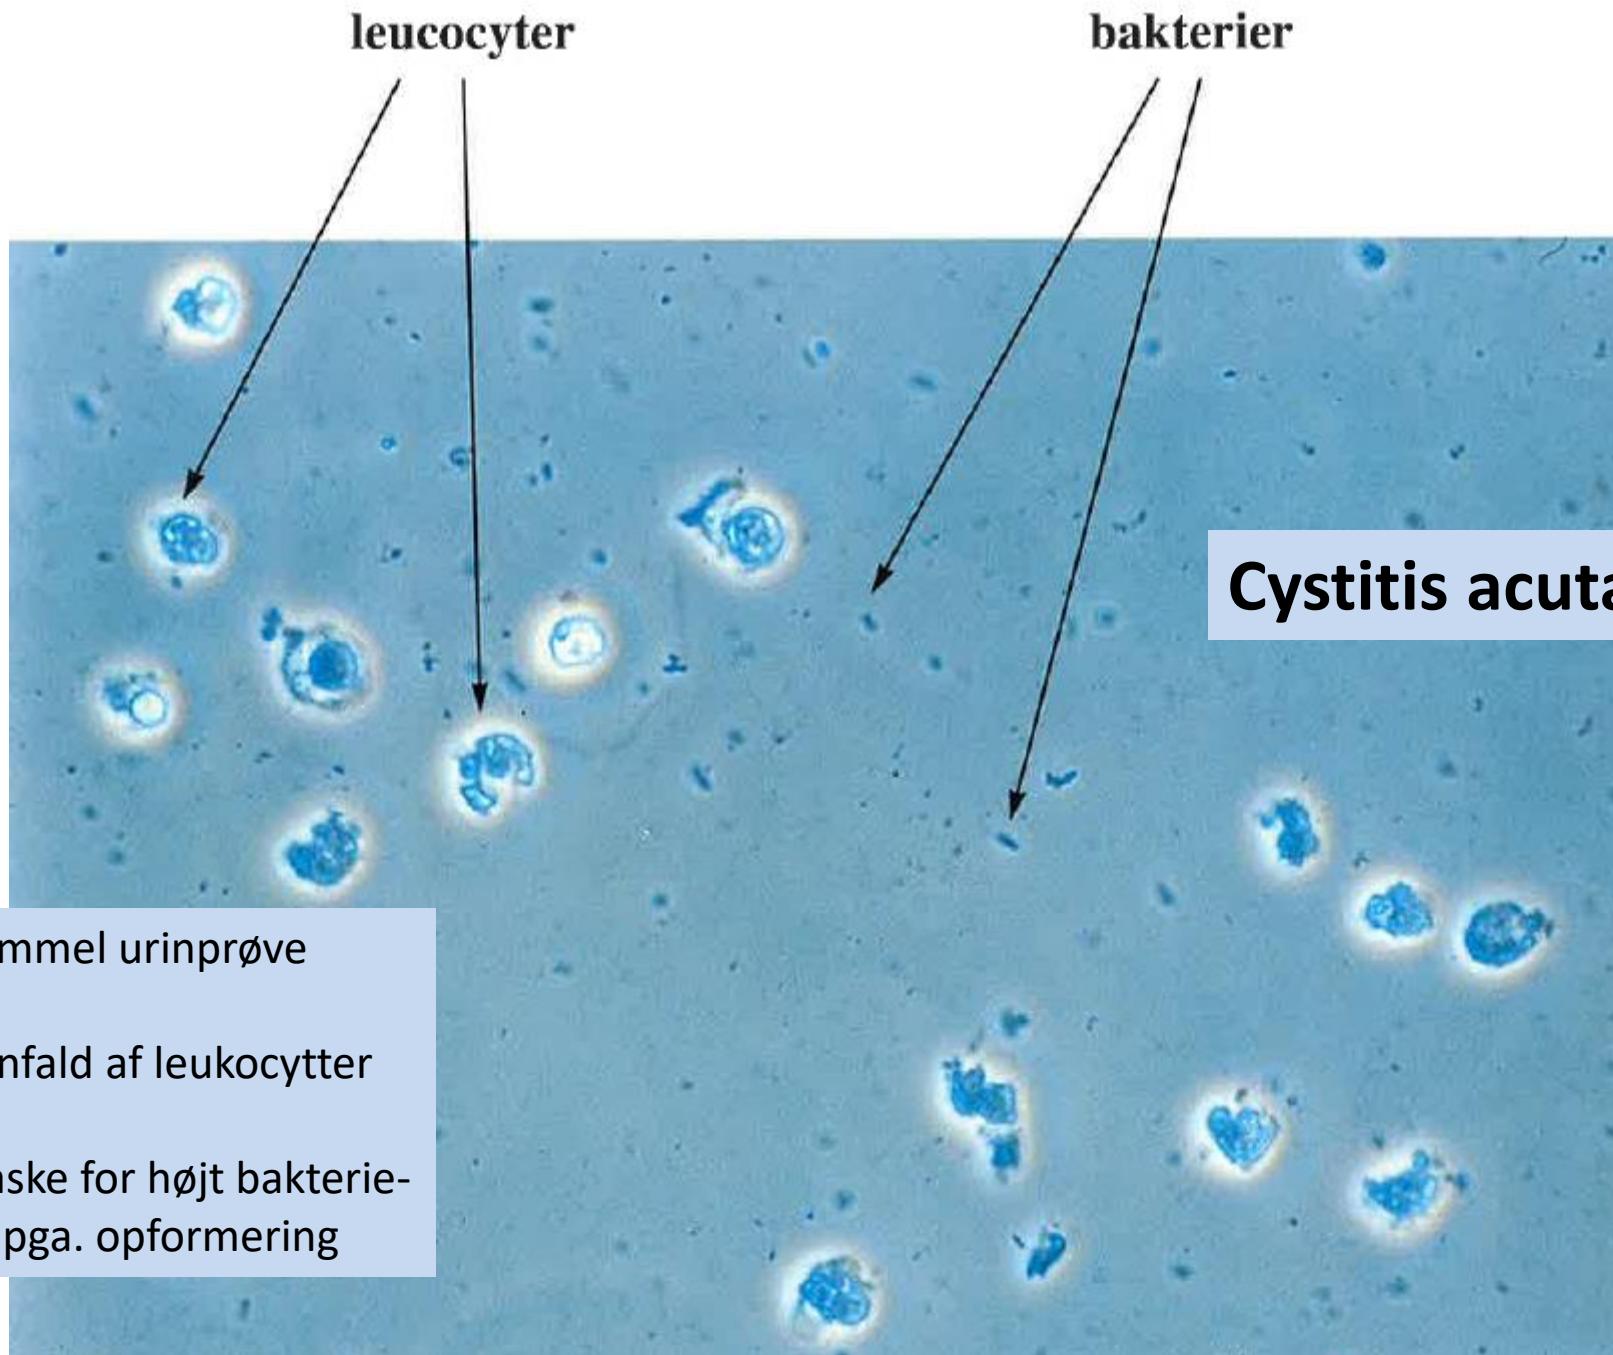

Gammel urinprøve


Henfald af leukocytter

Måske for højt bakterie-
tal pga. opformering

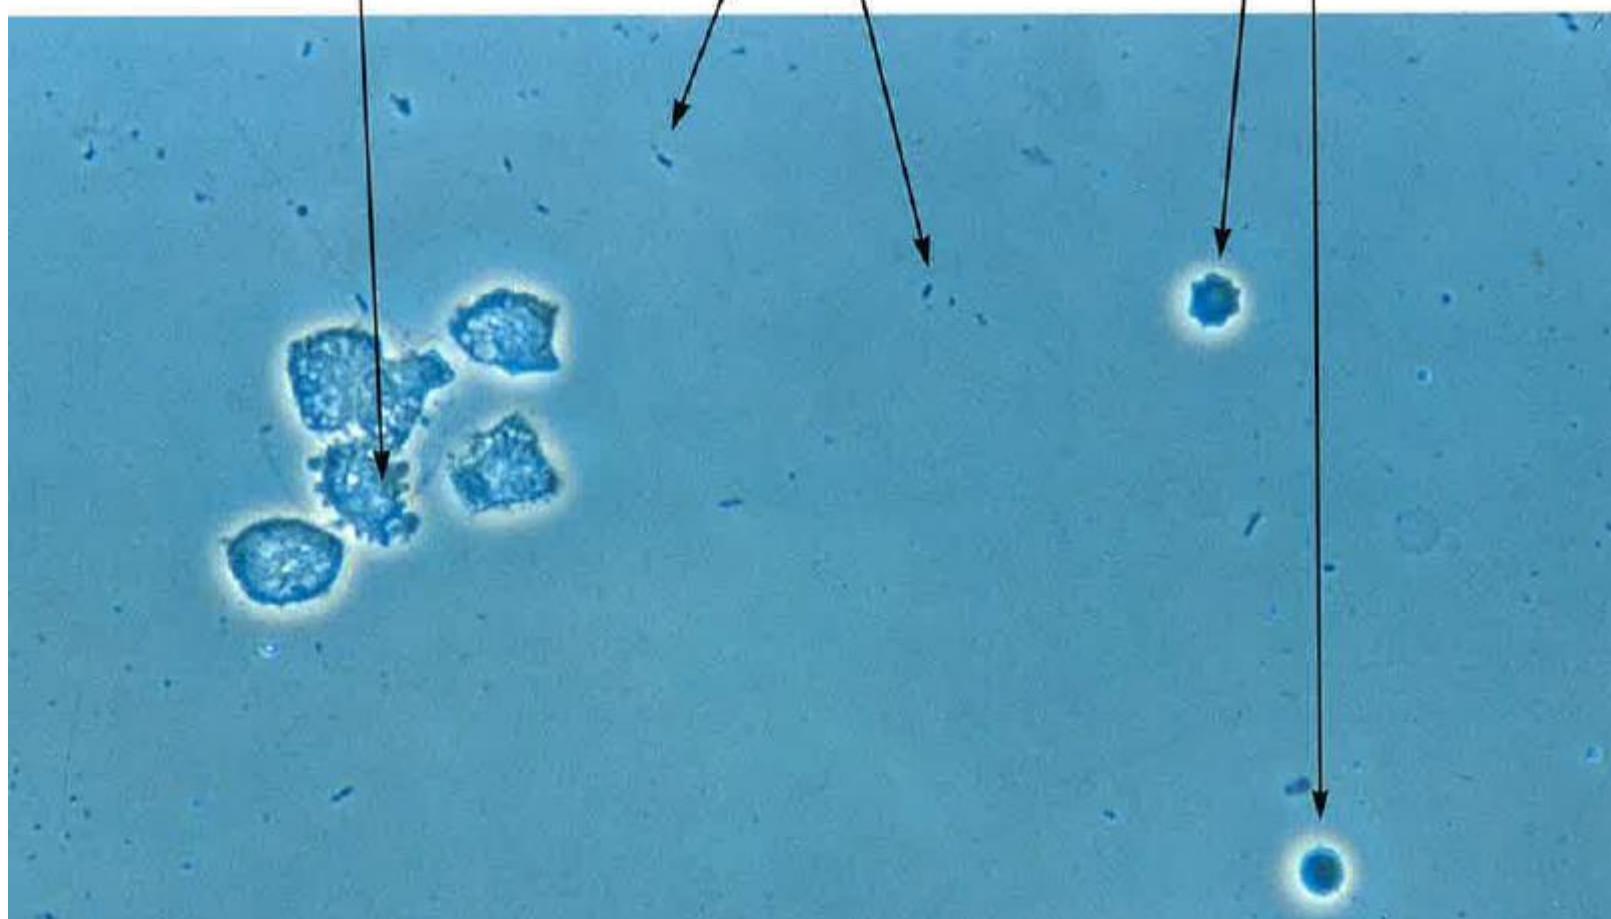

Cystitis acuta

Hæmorrhagisk cystitis
Erytrocytter er mindre end
leukocytter og er kerneløse

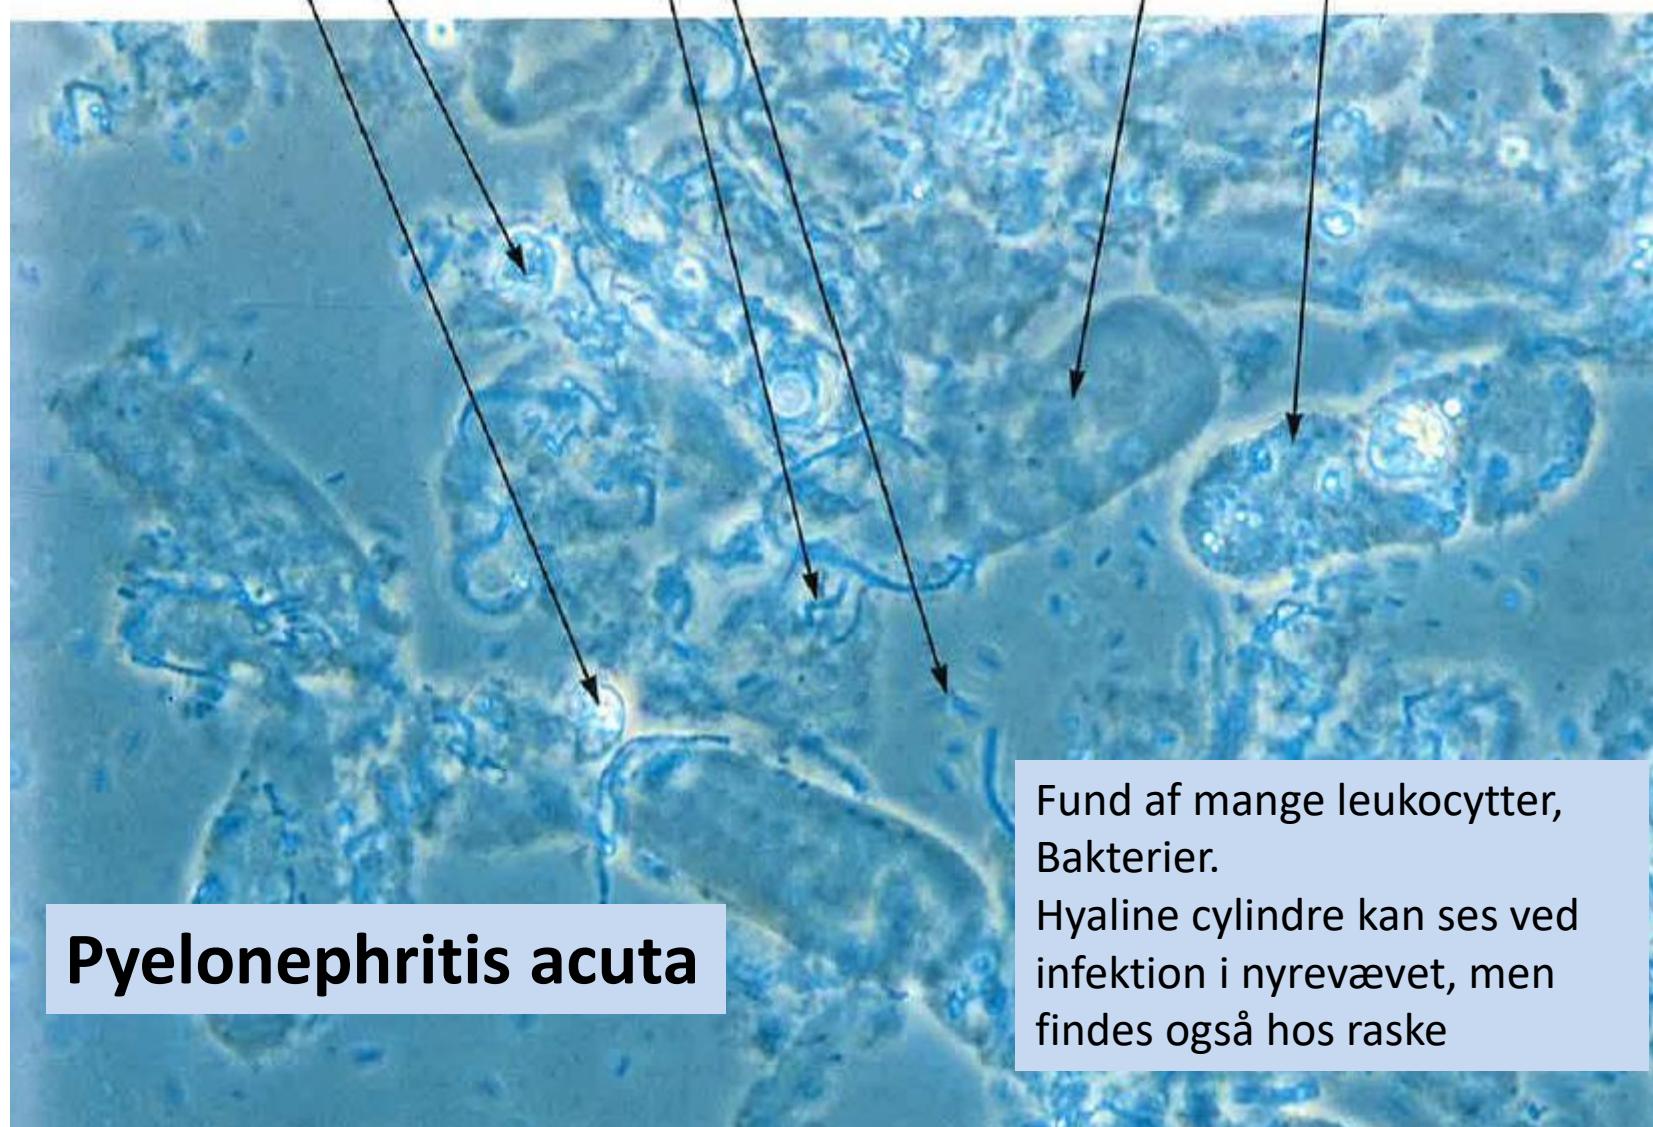


leucocytter

bakterier

hyaline cylindre


Fund af mange leukocytter,
Bakterier.
Hyaline cylindre kan ses ved
infektion i nyrevævet, men
findes også hos raske

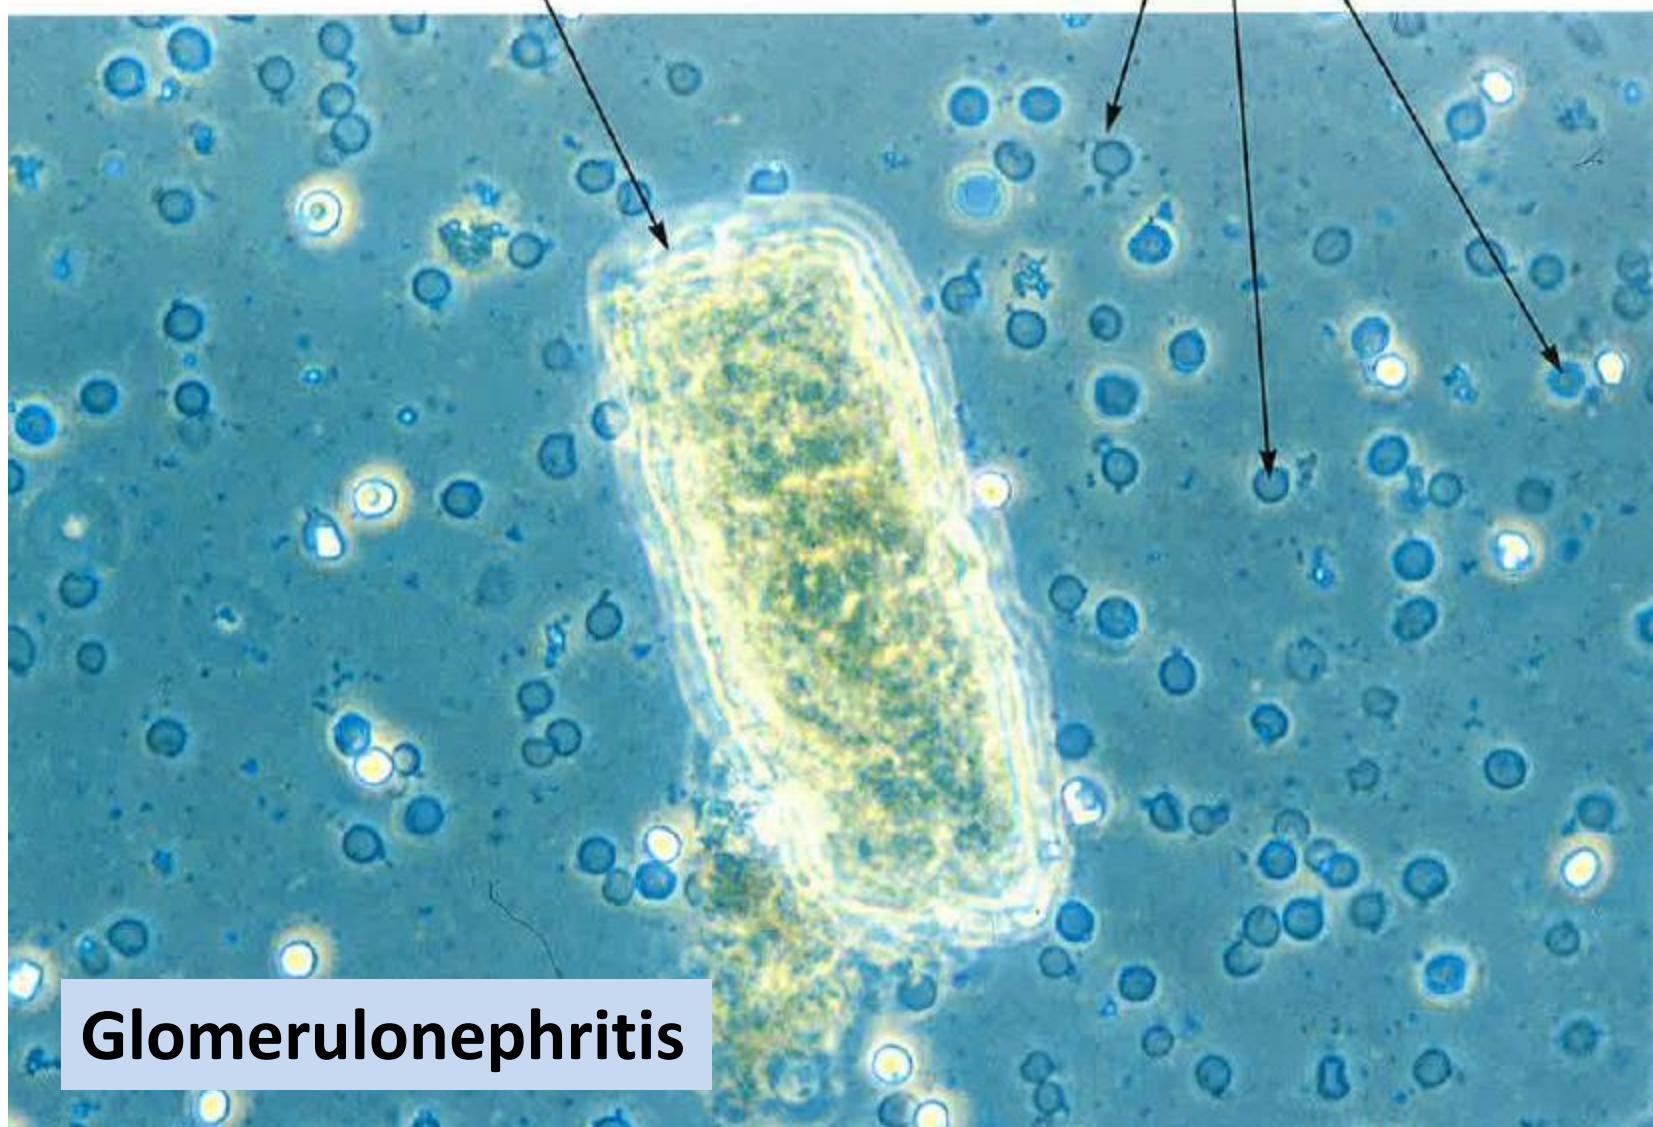


erytrocyt cylinder


erythrocyte

Glomerulonephritis

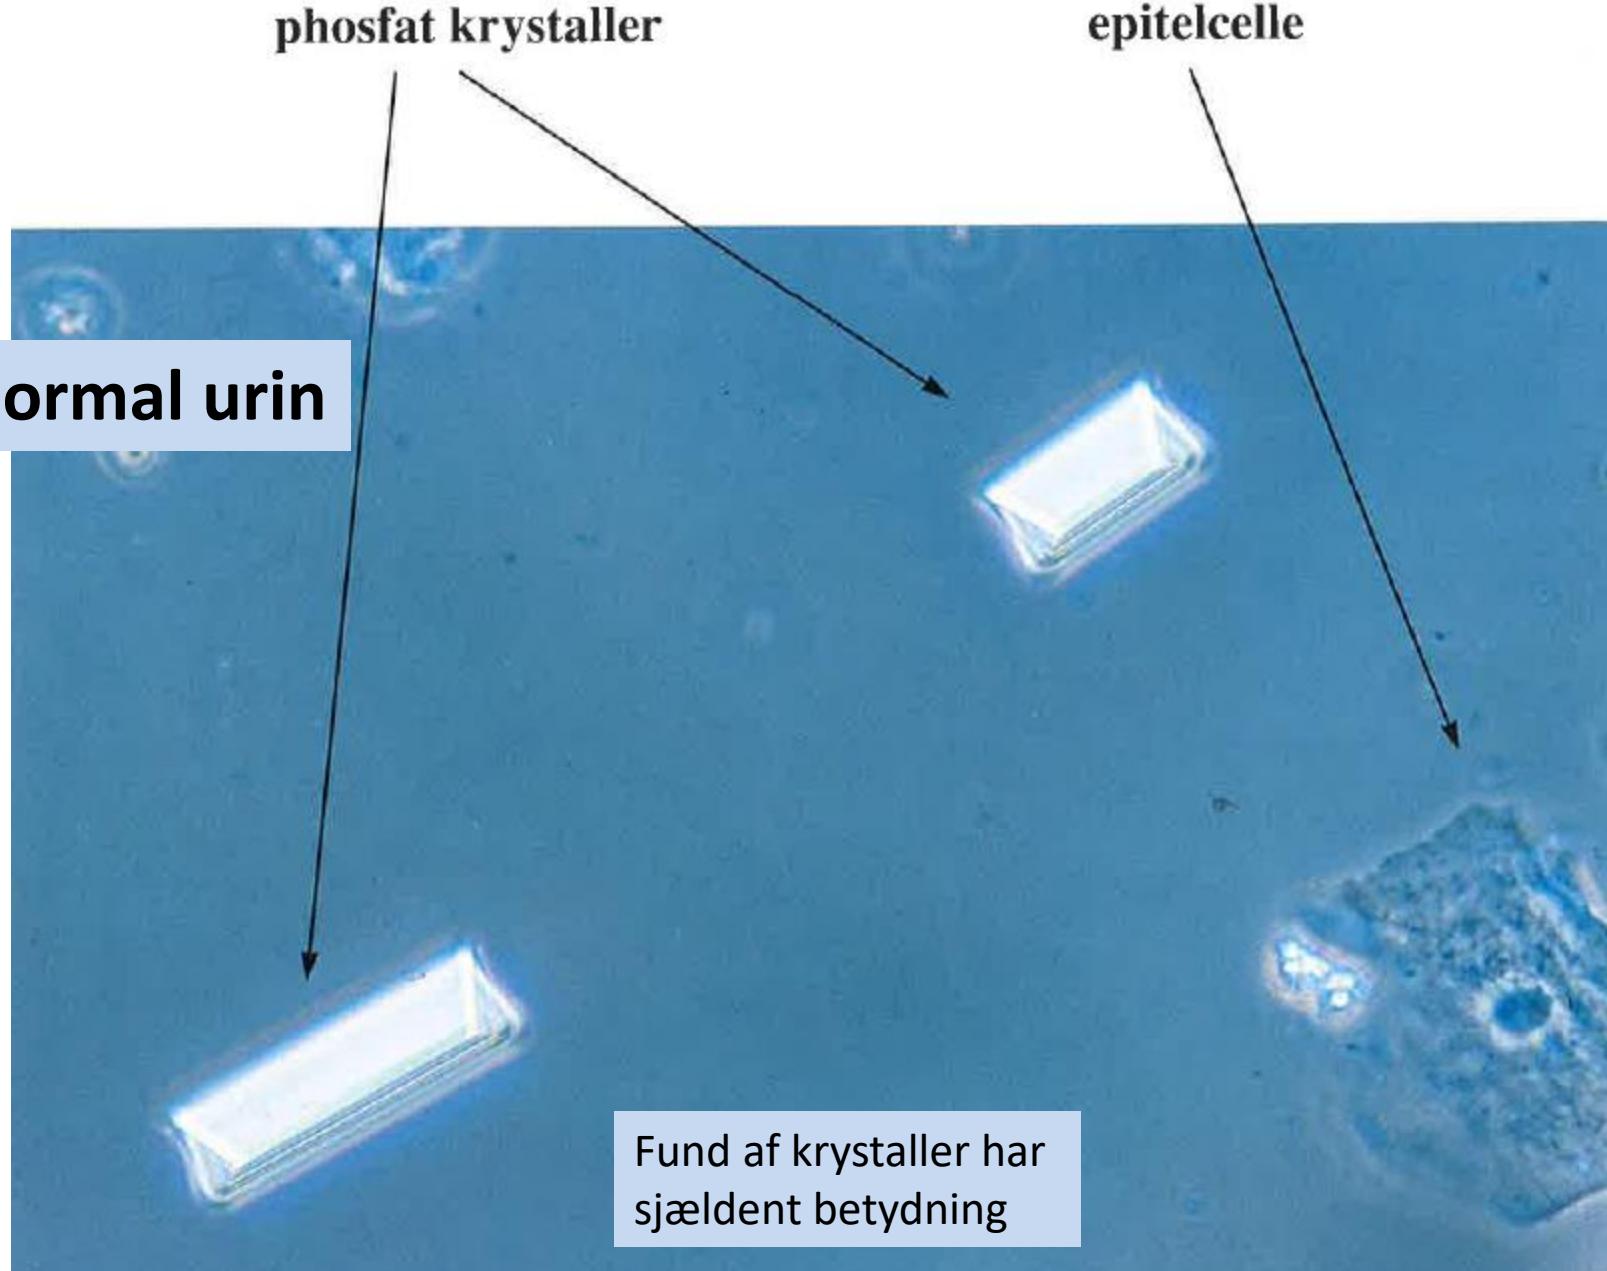

luftblærer

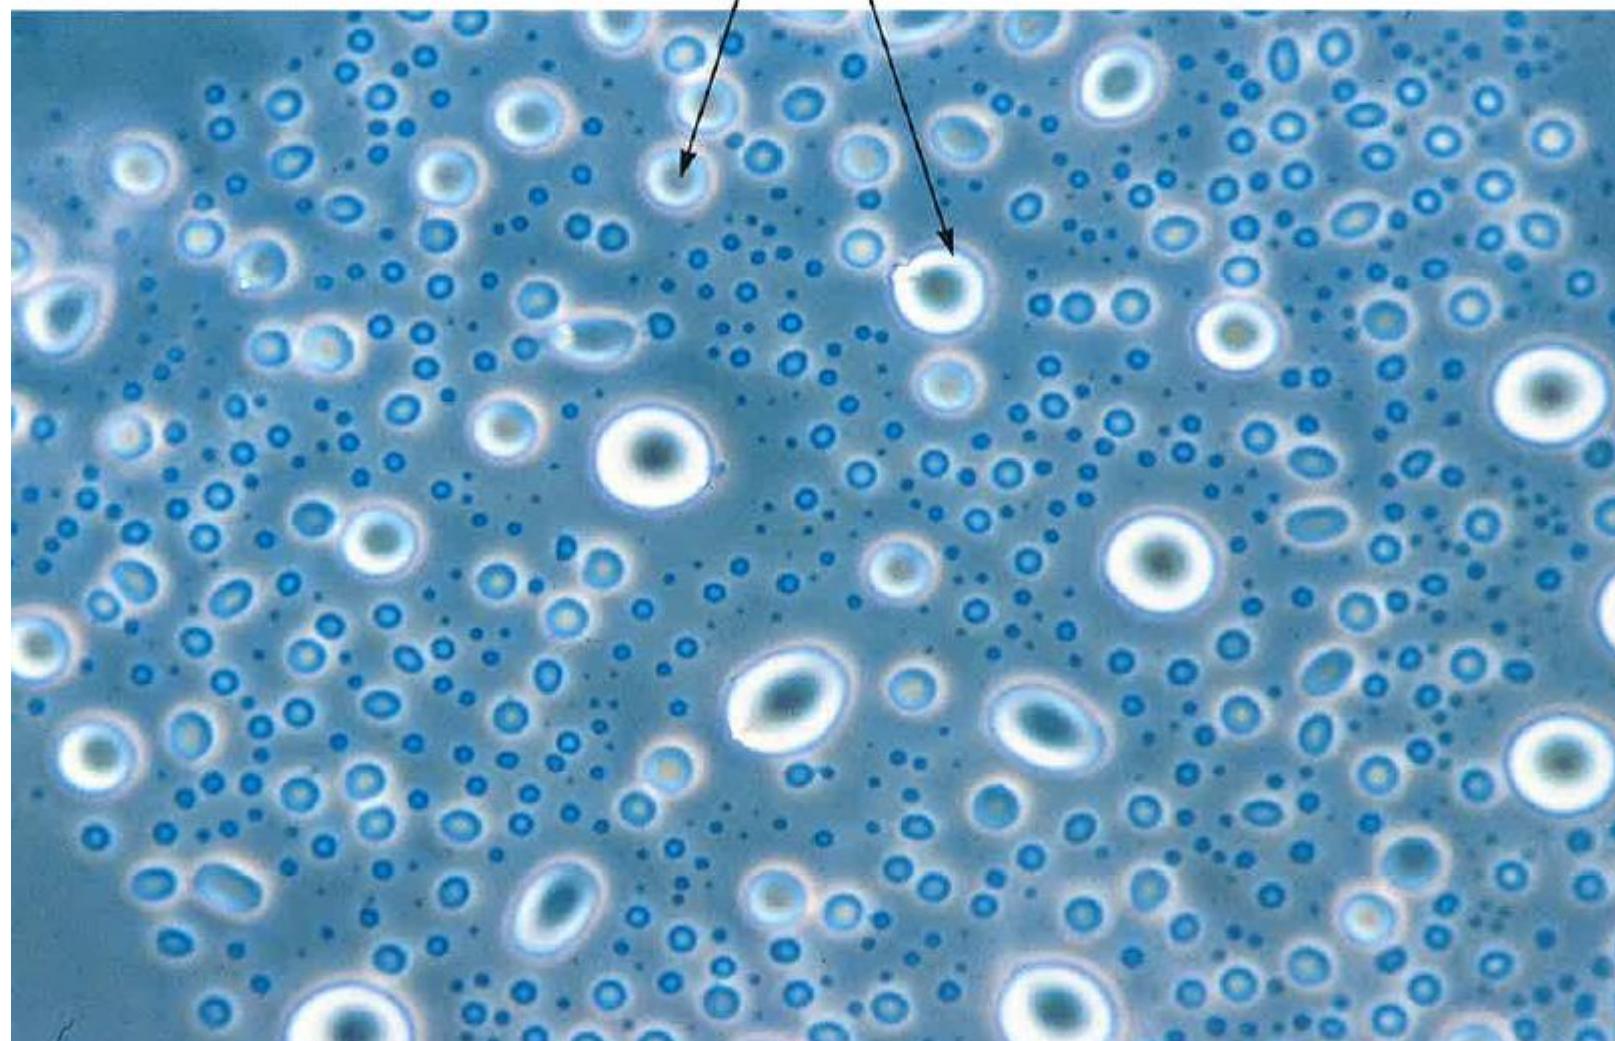

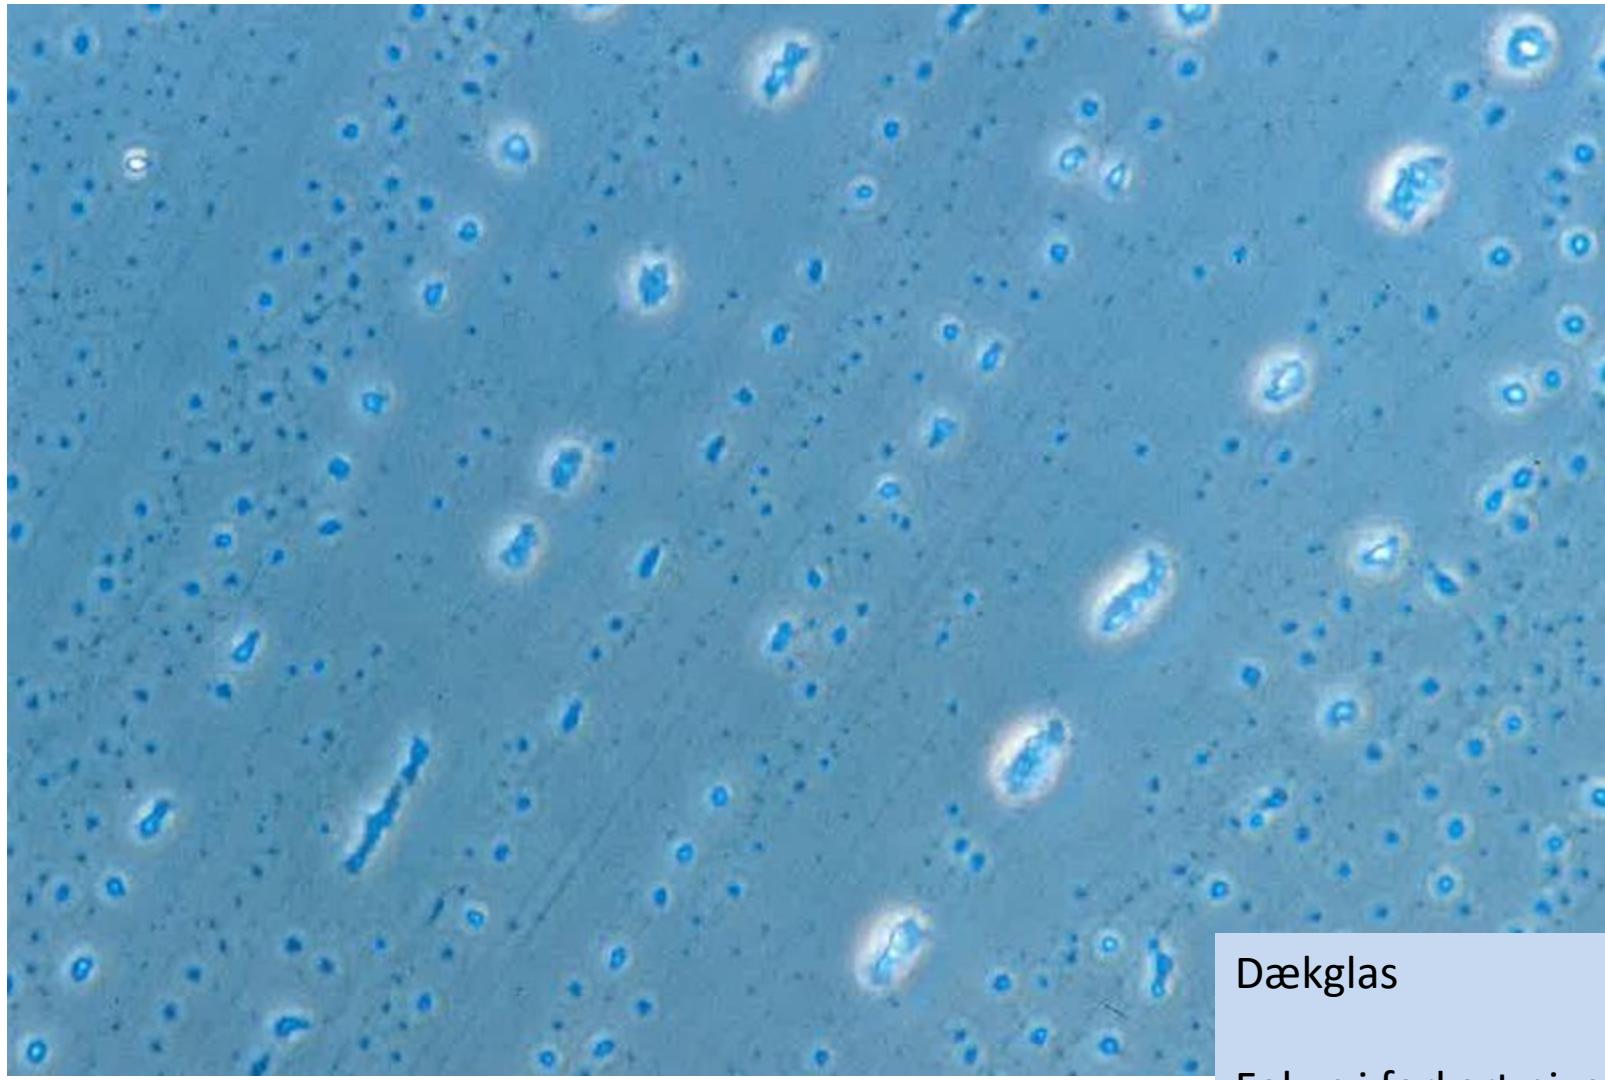

Dækglas

Fokus i forkert niveau

bakterier

glasskår (artefakt)

